



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 205ª Reunión Ordinaria



Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:35 horas del día 18 de mayo de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.



I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

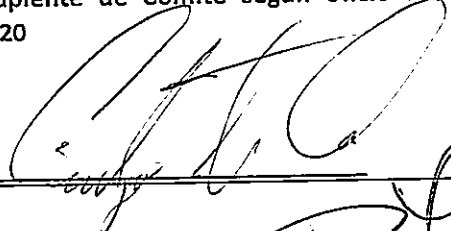C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022 
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18 	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020 

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

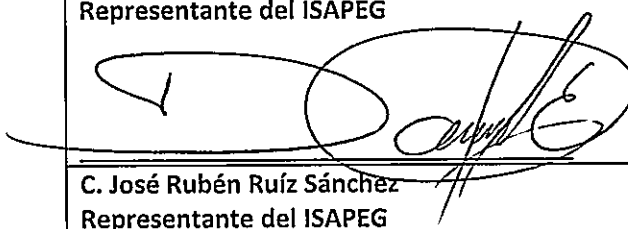

C. David Díaz Estrada Representante del ISAPEG 	C. Priscila Moran Tinoco Representante del ISAPEG 
C. José Rubén Ruíz Sánchez Representante del ISAPEG 	C. Daniel Alejandro Ledesma Pérez Representante del ISAPEG 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato:

Nombre	Firma
SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. C. Julián González Gómez	
GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. C. Gabriel Ortiz Borrego	
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. C. Naomi Omayra Acevedo Mancera	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones


- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) En el presente evento se hace entrega del anexo J Bis, dejando sin efecto el Anexo J.
- c) Se informa que se ponen a disposición en la Dirección de Adquisiciones y Suministros los planos y pruebas de seguridad radiológica (partidas 1 y 3) en formato digital, así mismo se publicará junto con la presente acta en la página electrónica de http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php.
- d) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal


La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.


Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

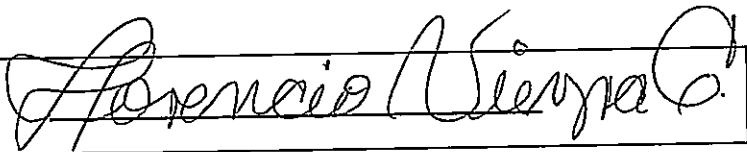



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las 11:50 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día 18 de mayo de 2023, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

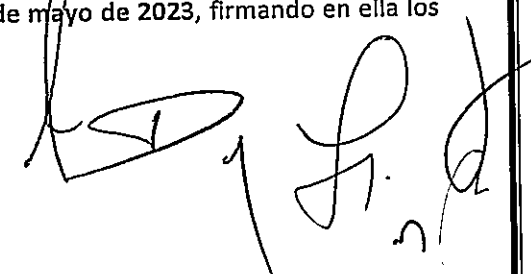

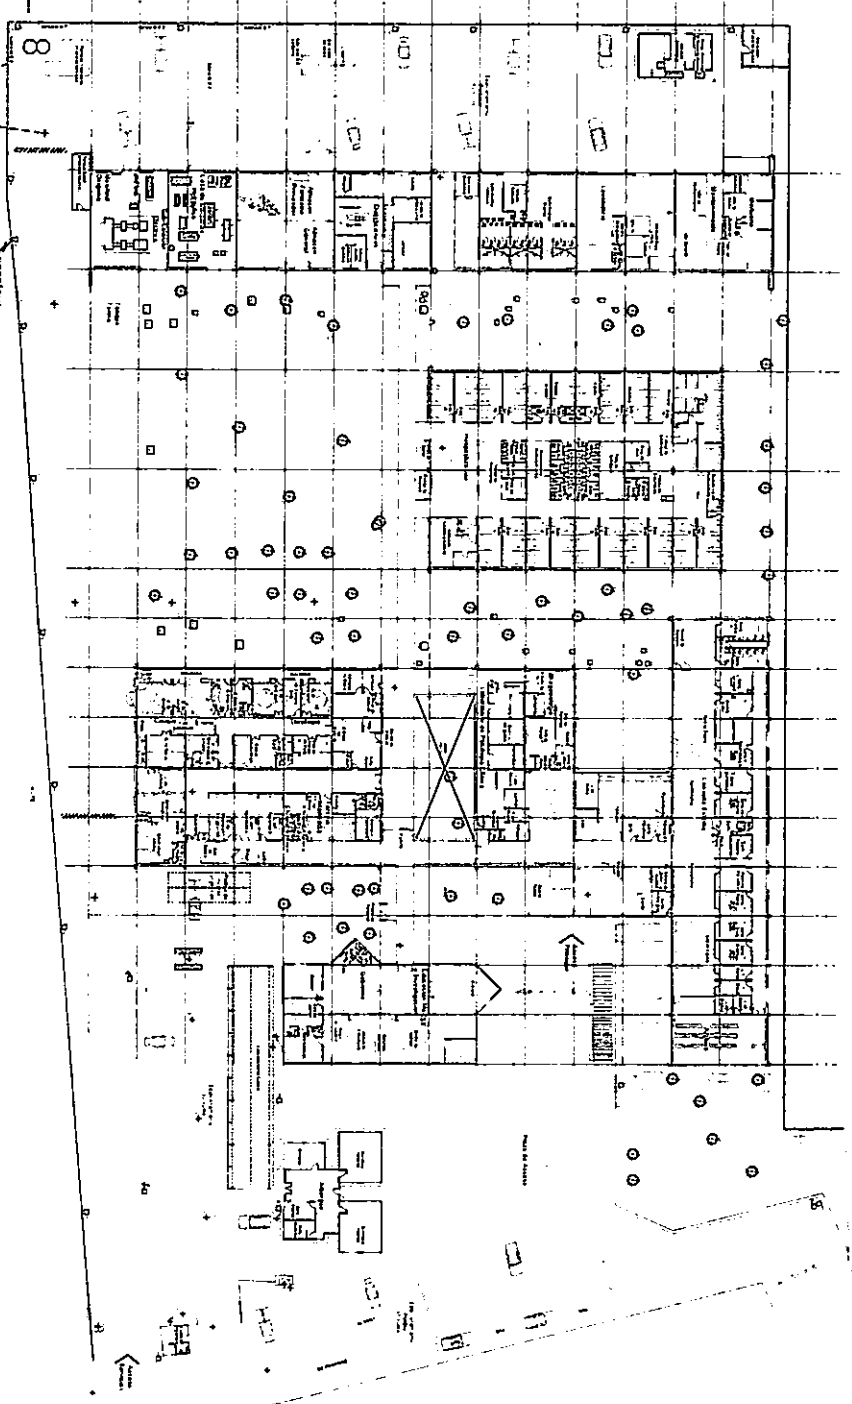

1. MONITORIO DE LA SALUD
2. MONITORIO DE LA SALUD
3. MONITORIO DE LA SALUD
4. MONITORIO DE LA SALUD
5. MONITORIO DE LA SALUD
6. MONITORIO DE LA SALUD
7. MONITORIO DE LA SALUD
8. MONITORIO DE LA SALUD
9. MONITORIO DE LA SALUD
10. MONITORIO DE LA SALUD

1. MONITORIO DE LA SALUD
2. MONITORIO DE LA SALUD
3. MONITORIO DE LA SALUD
4. MONITORIO DE LA SALUD
5. MONITORIO DE LA SALUD
6. MONITORIO DE LA SALUD
7. MONITORIO DE LA SALUD
8. MONITORIO DE LA SALUD
9. MONITORIO DE LA SALUD
10. MONITORIO DE LA SALUD

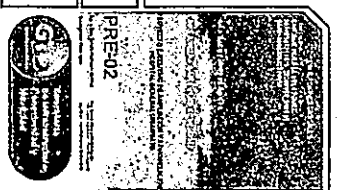


2

Handwritten signature and notes in the bottom left corner, including the letters 'F.C.' and 'G.N.'.




Handwritten signature and notes in the bottom right corner, including the letters 'G' and '23'.

PLANOS HOSPITAL GENERAL DE ACAMBARO

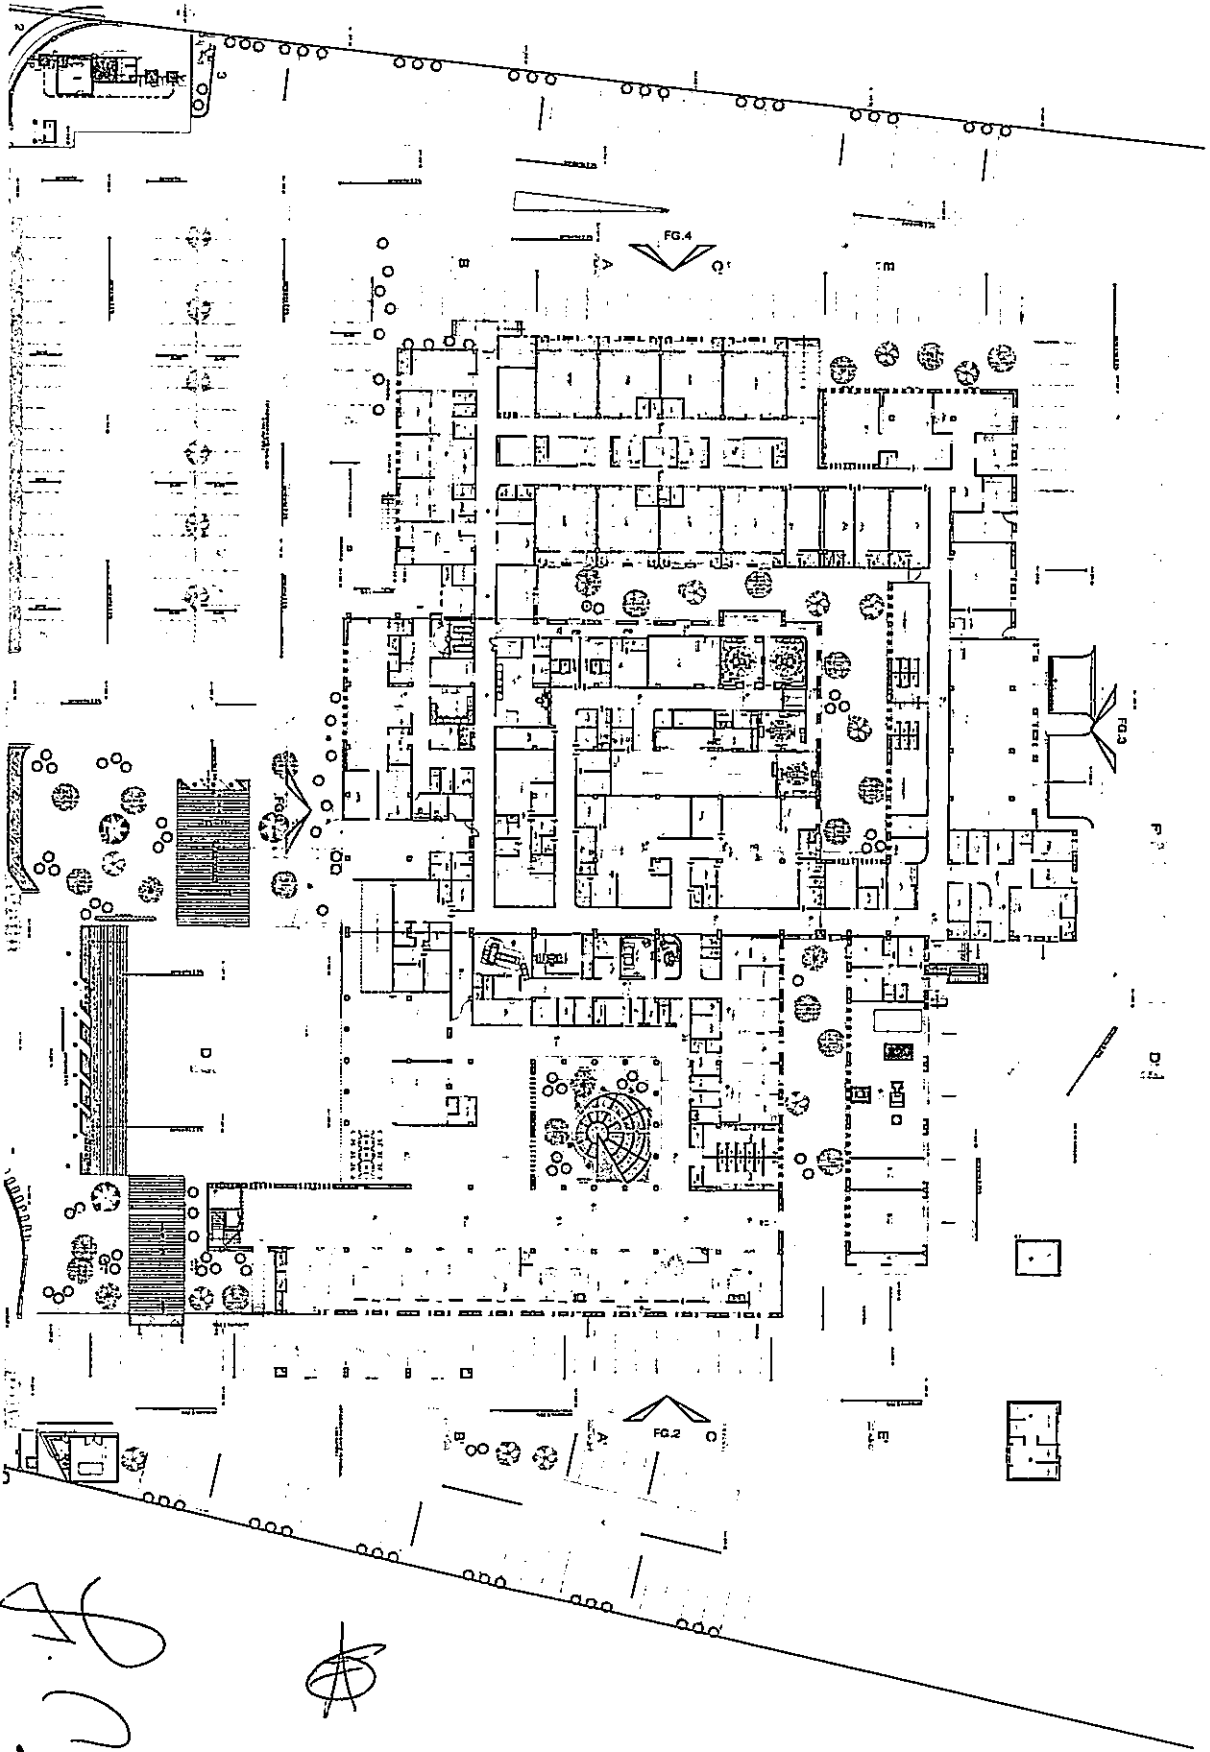

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

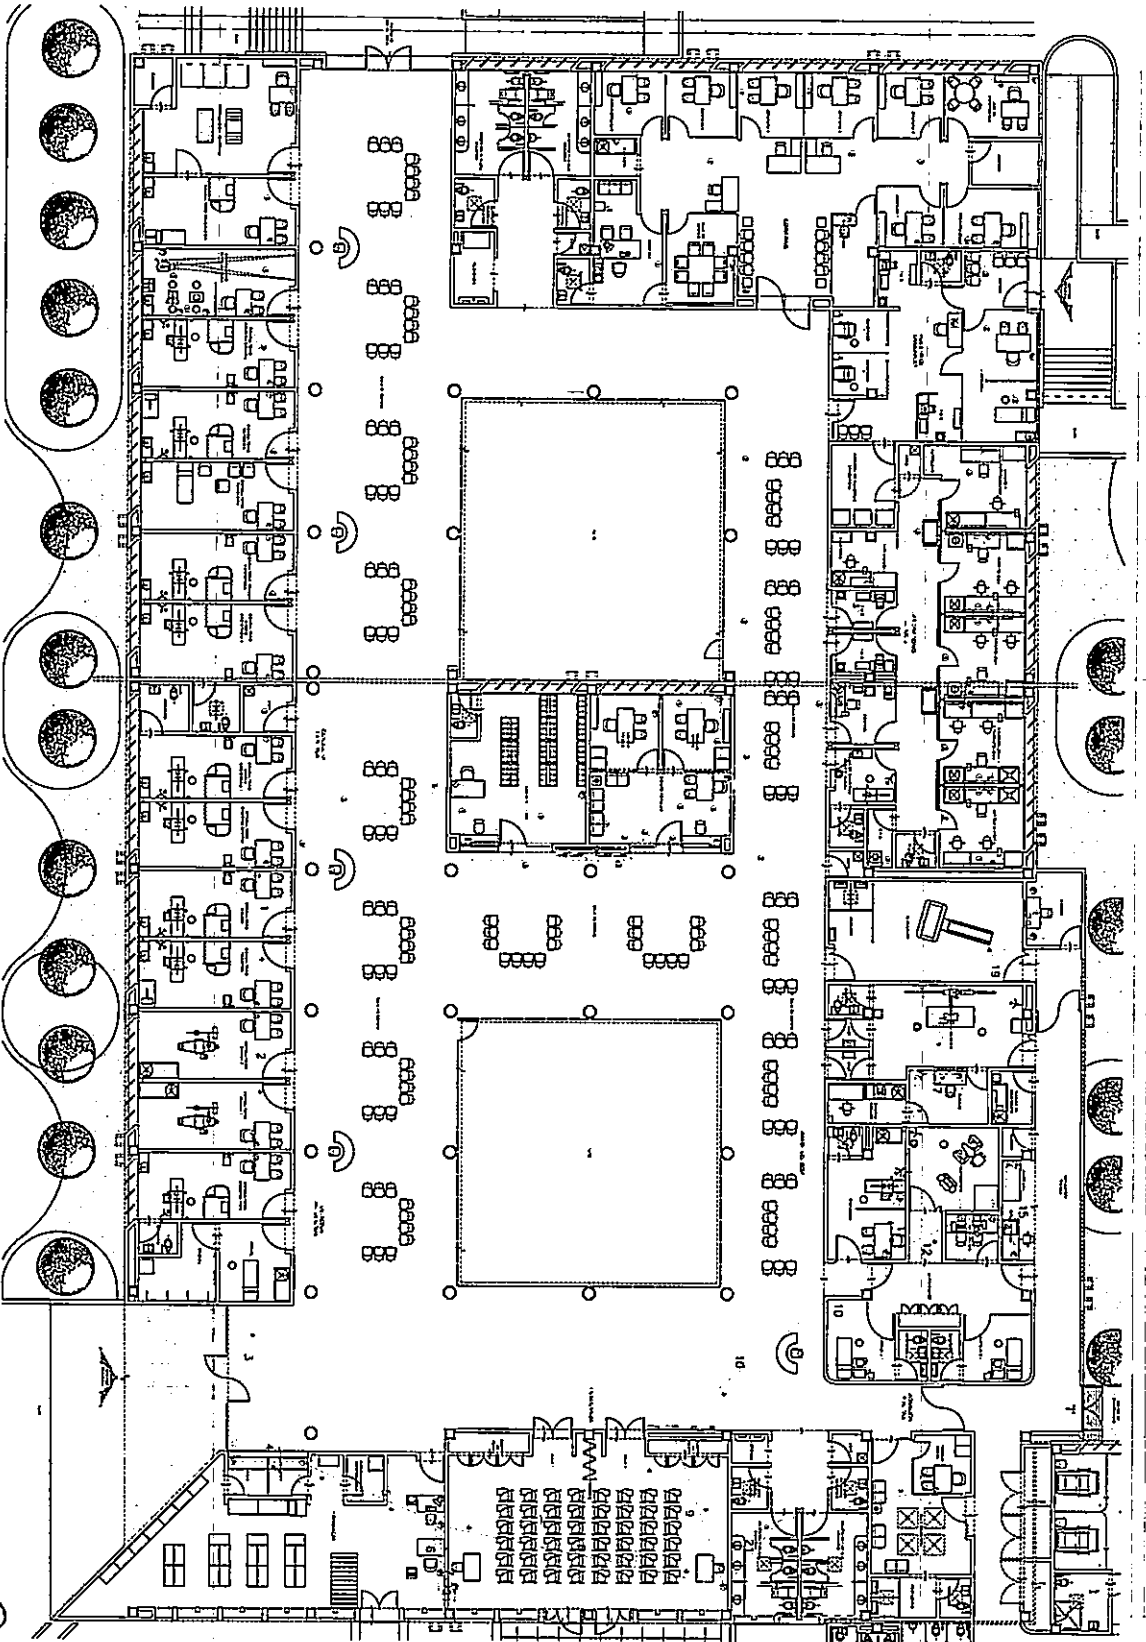

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

ANEXO J BIS REQUISITOS DE CALIDAD

[illegible]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	MODALIDAD DE LICITANTE	Carácter Administrativo	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	INSUMOS MÉDICOS MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.	X			Banqueta de altura Báscula con estadiómetro mecánica Carro para curaciones Mesa 150 cm para atención del recién nacido Mesa mayo Mesa para rehidratación Mesa pasteur Mesa puente Portovenoclisis rodable	11, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 31	ANEXO I (REQUISITOS DE CALIDAD)	EN EL ANEXO I, SOLICITAN EL ISO 13485:2016, (PARA LAS PARTIDAS QUE SE ENUMERAN) CONSIDERO QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO Y TRATANDO DE MOBILIARIO CLÍNICO, APLICARÍA SOLO EL ISO 9001:2015; YA QUE EL ISO 13485 QUE SOLICITAN ES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS (INSTRUMENTO, HERRAMIENTA, MÁQUINA, IMPLEMENTO O TRATAR LA ENFERMEDAD SE USAN PARA PREVENIR, DIAGNOSTICAR O TRATAR LA ENFERMEDAD U OTRAS AFECCIONES. LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS VAN DESDE LOS DEPRESORES HASTA LOS MARCAPASOS DEL CORAZÓN Y EL EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA) SOLICITO A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA PRESENTACIÓN DE ESTE ISO SEÑALADO EN EL ANEXO I, EN ESTAS PARTIDAS	Se aclara que en la presente Junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo I BIS (requisitos de calidad), dejando sin efecto el Anexo I.
1	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad Radiológica Digital para Estudios de Torax	1	2.3.1		Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
2	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad Radiológica Digital para Estudios de Torax	1	12.1		Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
3	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad Radiológica Digital para Estudios de Torax	1	12.6		Es correcta su apreciación.
4	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad Radiológica Digital para Estudios de Torax	1	13		Deberá considerar el autotransformador de acuerdo a su tecnología y condiciones actuales de la infraestructura de los Hospitales visitados. En caso de no necesitar el autotransformador, podrá presentar en su propuesta técnica la leyenda NO APLICA.
5	RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad Radiológica Digital para Estudios de Torax	1			Apegarse a lo solicitado en el numeral III. Presentación de ofertas, punto 1.17. En caso de que en los manuales, catálogos o documentación técnica, no haya referencia de la totalidad de los números de identificación de las partes que componen el bien, deberá presentar carta del fabricante donde indique el "No. de identificación de las partes que componen el bien ofertado" solicitados en el anexo I.

[Handwritten signatures and initials]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	Descripción del bien	Partida	Punto	Pregunta	Respuesta
6	RADIOLOGÍ A Y ELECTRÓNÍ CA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad RX Fluor Móvil Arco en C	2	2.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR 68KHU, TODA VEZ QUE CON ESTA CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DEL CALOR ES SUFICIENTE, PARA QUE EL EQUIPO TRABAE ADECUADAMENTE Y CUMPLA EL OBJETIVO PARA EL CUAL LA CONVOCANTE LO PRETENDE ADQUIRIR. ¿SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
7	RADIOLOGÍ A Y ELECTRÓNÍ CA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad RX Fluor Móvil Arco en C	2	14.4.7.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO UN ACHO EN EL RANGO DE 60 A 69 CM. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8	RADIOLOGÍ A Y ELECTRÓNÍ CA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					2	3.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE PUNTO SI OFERTAMOS UN PESO DEL ARCO DE 280 KG. NO SEBA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PORPUESTA. ES CORRECTO?	Se aclara que los puntos 3.5, 3.6 y 3.7 deben decir: " 3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR. 3.6. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20" 3.7. PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG." dejando sin efecto "3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR. 3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20" O PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG."
9	RADIOLOGÍ A Y ELECTRÓNÍ CA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad Radiológica Digital para Estudios de Torax Y Unidad RX Fluor Móvil Arco en C	1 Y 2	III Numeral 1.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL IMSS POSITIVA DE AL MENOS DOS DIAS NATURALES ANTERIORES AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, YA QUE AL SER UNA PROPUESTA PRESENCIAL, ES COMPLICADO PODER OBTENER LA CONSTANCIA DEL DIA DE LA APERTURA, CONSIDERANDO QUE NO TODA LA PROVEDURIA ES DEL ESTADO DE GUANAJUATO. ¿SE ACEPTA?	La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social se solicita con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación, por lo que podrá presentarla con fecha de al menos dos días naturales anteriores al acto de apertura.
10	RADIOLOGÍ A Y ELECTRÓNÍ CA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad Radiológica Digital para Estudios de Torax Y Unidad RX Fluor Móvil Arco en C	1 Y 2	III Numeral 1.14	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ESCRITO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL (ANEXO 5) DEBERA DE ESTAR SUSCRITO POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES Y/O EL PROPIETARIO DEL REGISTRO SANITARIO, EL CUAL PARA ESTE CASO ES EL RESPONSABLE Y CUENTA CON LA CAPACIDAD TECNICA PARA REALIZAR LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO	Deberá presentar el Anexo 5 con la firma del representante legal del licitante.
11	RADIOLOGÍ A Y ELECTRÓNÍ CA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad Radiológica Digital para Estudios de Torax Y Unidad RX Fluor Móvil Arco en C	1 Y 2	III Numeral 1.18 FC3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS DE ADJUNTAR EL REGISTRO SANITARIO DE ORIGEN DEL BIEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES ELABORADAS A ESTE REGISTRO DE ORIGEN AUNQUE SU ULTIMA PRORROGA ESTE VIGENTE ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación.
12	RADIOLOGÍ A Y ELECTRÓNÍ CA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X			Unidad Radiológica Digital para Estudios de Torax Y Unidad RX Fluor Móvil Arco en C	1 Y 2	III Numeral 1.18 FC3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CERTIFICADO SOLICITADO EN ESTE PUNTO NO LE APLICA A LAS PARTIDAS 1 Y 2. ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación. Se aclara que en la presente junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo J BIS (requisitos de calidad), dejando sin efecto el Anexo J.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CABALTEJA ADMINISTRATIVA	CABALTEJA TÉCNICA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	REGUNTA	RESPUESTA
1			X	Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1	1	CON LA FINALIDAD DE QUE SE ADQUIERAN EQUIPOS CON GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA CALIDAD, SUGERIMOS QUE EL GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA SEA DE 450KHZ O MAYOR, CON LO CUAL SE GARANTIZA UN RIZO (RIPPLE) DE ALTA TENSION, GARANTIZANDO UNA MEJOR CALIDAD EN LA CORRIENTE Y KILOVOLTAJE PARA UNA RADIACION UNIFORME EN TODA LA EXPOSICIÓN Y FINALMENTE OBTENER LA MÁXIMA CALIDAD DE IMAGEN DIAGNÓSTICA ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2			X	Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1	1.2	DE ACUERDO A LA POTENCIA SOLICITADA DE 50 KW, EL GENERADOR DEBERÁ ENTREGAR UNA CORRIENTE DE 630 MVA O MAYOR ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3			X	Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1	1.4	CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN GENERADOR QUE CUENTE CON OPCIÓN DE SELECCIÓN DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN SUFICIENTE DEPENDIENDO DEL PACIENTE Y ÁREA ANATÓMICA, SOLICITAMOS QUE EL GENERADOR CUENTE CON SELECCIÓN DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MILISEGUNDO A 5 SEGUNDOS O MAYOR ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4			X	Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1	1.1	CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS PROGRAMAS ANATÓMICOS SUFICIENTES PARA DIFERENTES TIPOS DE PACIENTE Y ÁREA ANATÓMICA LOS PROGRAMAS ANATÓMICOS DEBERÁN SER 1024 O MAYOR ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5			X	Unidad RX y Fluor Móvil Arco en C	2	2.2	SOLICITAMOS ANABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ANODO 314 KHU ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	Instal Pro, S.A. de C.V.		X	Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1		Entendemos que el equipo ofertado deberá tener la posibilidad de opcional generadores de línea, capacitor o UPS dependiendo de la alimentación eléctrica del sitio, ¿es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes. Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en cada una de las unidades médicas durante las vistas, son las definitivas y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes.
2	Instal Pro, S.A. de C.V.		X	Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1		Entendemos que en caso de ofertar columna portatubos con soporte a piso, no será necesario referenciar y cumplir con las especificaciones de soporte a techo, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
3	Instal Pro, S.A. de C.V.		X	Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1		En caso de que la pregunta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante nos permita referenciar un desplazamiento vertical de 160 cm, ¿se acepta?	No aplica su pregunta, en virtud de que la respuesta a su pregunta anterior no fue negativa.
4	Instal Pro, S.A. de C.V.		X	Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1		Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una matriz de 2836 x 2336 pixeles para el tamaño 14" x 17", garantizando la calidad de la imagen ya que el panel ofertado tiene una mayor sensibilidad a los rayos x, por el tipo de tecnología de adquisición tipo ISS así como un procesamiento avanzado de la imagen para reducción del ruido de la imagen y aumento del contraste, ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
5	Instal Pro, S.A. de C.V.		X	Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1		Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un tamaño de píxel de 150 micrones garantizando la calidad de la imagen, ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
6	Instal Pro, S.A. de C.V.		X	Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1		Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un DOE de 45%, garantizando una alta sensibilidad y calidad de imagen por la electrónica interna del detector de rayos x (ISS) que copia la radiación desde la parte más sensible del transistor, ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CATEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativo	carácter técnico	carácter legal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	Instal Pro, S.A. de C.V.		X		Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax	1	12.1.- CON MONITOR DE 23" O MAYOR Y RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 O MAYOR	Solicitamos a la convocante nos permita mejorar el monitor solicitado, ofertando un monitor clínico de 19" con resolución de 1 megapixel (1280 x 1024). ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
8	Instal Pro, S.A. de C.V.		X		POSIcionamiento DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS: SUJETADORES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS. SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS.	3	17.4.1. UN KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS. 17.4.2. UN KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES ADULTOS.	Solicitamos a la convocante sea opcional ofertar los accesorios para posicionamiento de estudios topográficos con la finalidad de garantizar el tiempo de entrega. ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
9	Instal Pro, S.A. de C.V.		X		Tomógrafo 64 cortes	3	VISTA GUADA A EL HOSPITAL GENERAL DE ACAMBARO	En la oferta a desarrollar por parte de los licitantes a esta partida, sera necesario incluir un UPS para el equipo de Tomografía? favor de aclarar	Si se refiere al punto 17.6, deberá ofertar Sistema UPS de 100KVA o mayor, para respaldo de al menos 10 minutos del sistema de tomografía, conforme a lo solicitado en el Anexo I de la presente licitación.
10	Instal Pro, S.A. de C.V.		X		Tomógrafo 64 cortes	3	VISITA GUADA A EL HOSPITAL GENERAL DE ACAMBARO	En el area destinada para este equipo actualmente hay un equipo de tomografía instalado, los alcances que sean tomados en cuenta por los licitantes para esta partida son: desinstalación y dejar empleado el equipo existente para dejar a disposición en el area que el ISAPEG destine para resguardo este equipo en el mismo hospital General de Acambato Guanajuato, favor de aclarar.	Se aclara que el proveedor deberá desinstalar el equipo actualmente instalado considerando mantener las condiciones actuales, desarmar y proporcionar los elementos del tomógrafo siendo posicionados en algún tipo de estructura, protegido con plástico, etiqueta con información del elemento y con manobra de resguardo dentro del mismo hospital que será indicado por personal responsable de mantenimiento y/o administración.
11	Instal Pro, S.A. de C.V.		X		Unidad Radiológica Digital para Estudios de Tórax / Tomógrafo 64 cortes	1 y 3 o para todas las partidas	1.18 Deberá presentar los certificados y documentos subnumeral FC1: Carta solidaria original del fabricante	Solicitamos a la Convocante que nos confirme en caso que la carta de apoyo del fabricante se elaborada y firmada por filial en México o distribuidor primario, adicional se tiene anexar documento que compruebe la relación comercial. Es correcto nuestra apreciación?	Podrá presentar la carta solicitada con la firma de la filial en México o distribuidor primario, siempre y cuando adjunten el documento de respaldo del fabricante que acredite a la filial en México o distribuidor primario.
1	IMAGMED S.A. DE C.V.		X		*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX *UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C *TOMÓGRAFO DE 64 CORTES *MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 *ECOCARDIOGRAFO 3D	1, 2, 3, 28 Y 34.	1.16 MANUALES, CATÁLOGOS	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita para los equipos Medicos Especializados, solo presentar impresas las hojas referenciadas de los Manuales, para no imprimir más de 500 hojas. Se acepta?	Podrá presentar impresas únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes, siempre y cuando presente de manera digital los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos para el equipo médico especializado, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.16.
2	IMAGMED S.A. DE C.V.		X		*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX *UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C *TOMÓGRAFO DE 64 CORTES *MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 *ECOCARDIOGRAFO 3D	1, 2, 3, 28 Y 34.	1.18 CARTA DE FABRICANTE SUB-NUMERALES FC1, FC5, FC6, FC7, CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE	Solicitamos amablemente a la Convocante que nos permita presentar cartas firmas electrónicas avanzadas certificadas por la notaría oficial mexicana NDM-151-SCFI-2016 de filial del fabricante en México. ¿se acepta?	Para los documentos solicitados en el numeral 1.18 (FC1, FC2, FC3 y FC4) podrá presentarse de esta manera.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	ASISTENTE LEGAL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX *UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C *TOMÓGRAFO DE 64 CORTES *MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 *ECOCARDIOGRAFO 3D	1. 2. 3. 28 Y 34.	1.18 CARTA DE FABRICANTE SUB- NUMERALES FC1, FC5, FC6, FC7, CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE	La Convocante está aceptando las "firmas electrónicas avanzadas certificadas por la NOM-151-SCFI-2016 para cualquier documento que se presente como por ejemplo carta de apoyo. Se Acepta?	Para los documentos solicitados en el numeral 1.18 (FC1, FC2, FC3 y FC4) podrá presentarlas de esta manera.
4	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX *UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C *TOMÓGRAFO DE 64 CORTES *MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 *ECOCARDIOGRAFO 3D	1. 2. 3. 28 Y 34.	1.18 CARTA DE FABRICANTE SUB- NUMERALES FC1, FC5, FC6, FC7, CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE	¿Aceptan firmas electrónicas avanzadas certificadas por la norma oficial mexicana NOM-151-SCFI-2016 para los documentos que debamos presentar?	Para los documentos solicitados en el numeral 1.18 (FC1, FC2, FC3 y FC4) podrá presentarlas de esta manera.
5	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX *UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C *TOMÓGRAFO DE 64 CORTES *MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 *ECOCARDIOGRAFO 3D	1. 2. 3. 28 Y 34.	1.18 SUB-NUMERALE FC2, CERTIFICADO ISO 13485 O ISO9001 de conformidad a lo solicitado en el Anexo J	Solicitamos amablemente a la Convocante que para cumplir con este punto nos permita presentar el certificado ISO 1385, esto debido que el certificado evalúa la calidad de los equipos ofertados. Se acepta?	Se aclara que en la presente Junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo J B15 (requisitos de calidad), dejando sin efecto el Anexo J.
6	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	1	Solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto como generador de alto voltaje. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
7	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	3.1.2.1.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una desplazamiento vertical de 150 cm , esto no afecta el desempeño clínico y esta dentro de los márgenes técnicos estándar. ¿Se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
8	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	5.2	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un detector con una matriz de imagen de 2840 x 2874, este parámetro no esta lejos de lo solicitado ¿Se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
9	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	5.5.	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una micra de 150, el parámetro se encuentra de los niveles competitivos y no afecta la calidad de imagen. ¿Se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativo	carácter técnico	carácter clínico	carácter diagnóstico	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
10	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	11	Solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto como "Exámenes anatómicos programables" ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto, acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación. En caso de que no pueda referenciarlo, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
11	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	12.1	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una pantalla a color táctil de 19", aseguramos que esto no demerita la presentación de las imágenes ni el rendimiento, ¿Se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
12	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	12.3	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un disco duro de 480GB este parámetro esta cercano a lo solicitado, además de que cumplimos con las 10000 imágenes de almacenamiento, ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13	IMAGYMED S.A. DE C.V.	X				*UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	II. Información específica de la licitación g) Lugar y tiempo de entrega	Solicitamos amablemente a la convocante la ampliación de tiempo de entrega a 120 días, para garantizar en calidad y precio, se acepta?	Se aclara que para las partidas 1, 2, 3 y 34 del Anexo I, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día 09 de octubre de 2023; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para esta partida en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
14	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	1.16 MANUALES, CATÁLOGOS	Con el objetivo de disminuir el impacto ecológico de manejar y entregar material impreso y considerando el cada vez mayor desuso que tienen los manuales impresos. Solicitamos a la convocante, nos permita entregar el manual de operación del fabricante en español y en formato digital ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrá presentar impresos únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes, siempre y cuando presente de manera digital los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos para el equipo médico especializado, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.16.
15	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR.	Entendemos que el recorrido vertical es muy importante para el posicionamiento por debajo de la mesa del tubo de rayos X, la flexibilidad para el posicionamiento respecto de la mesa, disminuye la dosis y mejora la imagen al lograr colocar el detector más cerca del área de interés. Ponemos a consideración de la convocante que el recorrido vertical sea motorizado e igual o mayor a los 46 cm ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes. Se aclara que los puntos 3.5, 3.6 y 3.7 deben decir: " 3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR. 3.6. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20° 3.7. PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG." dejando sin efecto "3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR. 3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20° O PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG."

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	ASISTENTE LICITANTE	CARACTER ADMINISTRATIVA	ASISTENTE TÉCNICO	CARACTER TÉCNICO	LEGATARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
16	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	4.1. ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 15 BITS O MAYOR.	Solicitamos a la convocante, nos permita referenciar este punto como "conversión analógica/digital de 16 bits", dado que la profundidad de imagen se refiere a la cantidad de bits de información necesarios para guardar información en un pixel en una imagen digital y la conversión analógica/digital del detector corresponde a la etapa de adquisición de la imagen. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre el cumplimiento de las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
17	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	4.2. MATRIZ DE 1500 X 1500 PÍXELES O MAYOR.	Cuando se habla de pixel se hace referencia a la unidad de menor tamaño dentro de una imagen digital. Entre más pequeño sea el tamaño y mayor sea el número de píxeles en un área determinada, más definida y real se podrá ver la imagen. Ponemos a consideración de la convocante que la matriz de píxeles sea de 1900 x 1900 píxeles o mayor ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
18	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	4.4. TAMAÑO DEL PÍXEL DE 200 MICRONES O MENOR.	Cuando se habla de pixel se hace referencia a la unidad de menor tamaño dentro de una imagen digital. Entre más pequeño sea el tamaño y mayor sea el número de píxeles en un área determinada, más definida y real se podrá ver la imagen. Ponemos a consideración de la convocante que el tamaño del píxel sea igual o menor a los 160 micrones ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
19	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	6. FLUOROSCOPIA PULSADA DE 25 IMÁGENES O CUADROS/SEGUNDO O MAYOR.	En caso de que estos equipos no se vayan a utilizar para procedimientos de cardiología, en los cuales se ocupan velocidades de adquisición de hasta 30 imágenes por segundo. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar fluoroscopia pulsada de hasta 15 imágenes o cuadros por segundo. Nuestras opciones de adquisición permiten disminuir el emborronamiento en la imagen sin la necesidad de aumentar la velocidad de adquisición, lo cual permite controlar la dosis y reducir los artefactos por movimiento. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
20	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	7.8. FILTRO DE MOVIMIENTO (PEDESTAL, RESPIRACIÓN).	Solicitamos a la convocante, nos permita referenciar este punto como "El desplazamiento de píxeles en tiempo real compensa los artefactos de movimiento" y los "botones de reducción de desenfoque y reducción de ruido, ajustan aún más el nivel de reducción de ruido temporal a la cantidad de movimiento en la región de interés", dado que estas son las características de procesamiento de imagen para filtrar el movimiento ocasionado voluntaria o involuntariamente por el paciente. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre el cumplimiento de las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
21	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X			*UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	7.9. FILTRO DE DOSIS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS.	Solicitamos a la convocante, nos permita referenciar este punto como "Filtración total del haz de 4.73 mmAl" y "Directrices contra la radiación en pacientes pediátricos. Características de diseño importantes para las imágenes pediátricas: Selección de procedimiento, Selección del nivel de dosis, Selección de velocidad de impulsos, Rejilla extrínseca, Control de dosis automática, Dispositivos de dirección del haz", dado que estas son las características de procesamiento de imagen y de diseño de nuestro arco para mejorar la calidad de imagen y reducir la radiación en pacientes pediátricos. Considerándose la rejilla extraíble y la filtración total del haz de rayos X como importantes recursos para filtrar la dosis en pacientes pediátricos. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre el cumplimiento de las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Junta de Aclaraciones

No. de Pregunta	Licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	Descripción del Bien	Partida	Punto	Pregunta	Respuesta
									Se aclara que para las partidas 1, 2, 3 y 34 del Anexo I, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día 08 de octubre de 2023, dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para esta partida en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apearse a la fecha señalada en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
22	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	11. Información específica de la licitación el lugar y tiempo de entrega	Solicitamos amablemente a la convocante la ampliación de tiempo de entrega a 120 días, para garantizar en calidad y precio, se acepta?	
23	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	1. EQUIPO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CON UN TIEMPO DE RASTRO HELICOIDAL Y AXIAL EN GIRO COMPLETO 360° EN 0.35 O MENOR. APLICABLE A TODAS LAS REGIONES DEL CUERPO.	Solicitamos muy atentamente se nos permita referenciar esta característica como un tiempo de rastreo helicoidal y axial en giro completo de 360 grados a 0.5 segundos en el entendido que puede usarse en cualquier paciente y estudio, favor de confirmar?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
24	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	3.4. COBERTURA DEL DETECTOR DE 38MM O MAYOR.	Dado que los equipos solicitados son para hospitales de tercer nivel de atención, es decir de alta especialidad, sugerimos a la convocante que la cobertura sea al menos de 40 mm, lo que permitirá resaltar estudio cardiológicos en pacientes con taquicardias y arritmias, así como pacientes pediátricos con malformaciones congénitas, se reducirá la dosis de radiación para todos los estudios ya que el tiempo de exposición a la radiación disminuirá, la resolución temporal de las imágenes se verá beneficiada, aumentará la certeza de los estudios y se logrará dar mejor atención y cuidados al paciente, favor de confirmar?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
25	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	5.1. TUBO DE RAYOS X CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ANCHO DE 7 MM O MAYOR, RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA.	Creemos que la capacidad solicitada como capacidad de almacenamiento de calor no es suficiente para un equipo de 64 cortes ya que estará enfocando a atender una cantidad elevada de pacientes y de acuerdo a las aplicaciones clínicas solicitadas en las bases, se necesitará un equipo que pueda hacer sin ninguna limitante estudios de cardiología avanzada, perfusión de órganos, trauma entre otros lo que demanda del equipo muchos disparos de rayos X y podría calentar el tubo y tener la desventaja de sufrir paros por calentamiento del sistema, por tanto solicitamos que este valor sea de cuando menos 8 MHU o mayor para evitar lo antes mencionado y sin efecto de reconstrucción iterativa, es decir, que sean valores nominales para garantizar que la medida de MHU sea absoluta y no relativa por dicho efecto de reconstrucción iterativa, favor de confirmar?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
26	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		*TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	17.4.1. UN KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS.	Solicitamos muy atentamente se nos permita colocar todo el set de posicionadores y cintas de sujeción que contiene el equipo tanto para los estudios de adulto como de pediátrico, favor de confirmar?	Apearse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
27	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		ECCOCARDIOGRAFO 3D	34	44. CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO PARA RECONSTRUCCIÓN AUTOMÁTICA DEL VD, CON MEDICIONES AUTOMÁTICAS O SEMIAUTOMÁTICAS DE VOLUMENES DIASTÓLICO Y SISTÓLICO, FRACCIÓN DE EXPULSIÓN DEL VD, VOLUMEN LATINO, CAMBIO DE ÁREA FRACCIÓNAL STRAIN GLOBAL.	Solicitamos amablemente a la convocante que la función de reconstrucción automática del VD sea una solución integrada a la propuesta económica, debido a la importancia que ha tomado la evaluación del VD en años recientes. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativo	carácter técnico	carácter legal	Descripción del bien	Partida	Punto	Pregunta	Respuesta
28	IMAGYMED S.A. DE CV.		X		ECOCARDIOGRAFO 3D	34	50.2. CON CAPACIDAD PARA ACEPTAR TRANSDUCTORES DESTINADOS A ECOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA.	Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si se deberá ofertar transductor transesofágico matricial con capacidad de imagen tridimensional.	Deberá ofertar un equipo con la capacidad para aceptar transductores destinados a ecografía transesofágica.
1	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		TOMOGRAFO 64 CORTES 50532323	3	2	Solicitamos a la convocante nos indique si es posible ofertar un equipo de tomografía con la capacidad de reconstrucción por IVR de hasta 64 cortes, se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás plicantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto.
2	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		TOMOGRAFO 64 CORTES 50532323	3	3,4	Solicitamos a la convocante que ante la imposibilidad de hacer una referencia o marcaje en nuestra bibliografía nos permita suministrar una carta de fabricante con firma para demostrar esta característica ¿se acepta?	En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características por partida.
3	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	1	Solicitamos amablemente nos permitan referenciar este punto como "Frecuencia del generador ≥ 100 kHz", lo cual cumple con el requerimiento de "alta frecuencia". ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
4	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	1.1	Considerando los altos índices de obesidad en nuestro país, recomendamos amablemente a la convocante solicite un generador de al menos 80kW y 800 mA, para asegurar un desempeño correcto del sistema incluso en pacientes con obesidad. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	3.1.1	Entendemos que en caso de ofertar sistema con SOPORTE A PISO, los puntos 3.1.2 y 3.1.3 (y sus subpuntos) deberán indicarse como "No Aplica". ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
6	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	7	Por temas meramente de referenciación solicitamos amablemente nos permitan referenciar este punto como "Rejilla Pb 13/92", lo cual en nuestra nomenclatura indica una relación 13:1 y 92 LP/cm, lo cual cumple con lo solicitado ¿se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
7	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1		Solicitamos amablemente a la convocante a que se refiera la siguiente indicación: "INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 2,5,6,8,12,6"	En caso de que no pueda referenciarlo, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
									Se refiere a los números, códigos o claves de identificación de partes que integran el bien. Deberán presentar en su oferta técnica (Anexo A) los números de parte solicitados en el Anexo I.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativo	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV	X			UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	1.1. Potencia de 15kW o mayor	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar nuestro equipo que cuenta con una salida de potencia de 12 kW, alcanzando un potencia de salida máxima nominal de 15 kW, lo que hace posible realizar una gran gama de procedimientos y no representa una limitante para las aplicaciones clínicas para las que se ha desarrollado el equipo, ya que permite realizar desde procedimientos ortopédicos hasta estudios cardiológicos. El contar con esta potencia no demerita la calidad de imagen, así mismo el equipo cubre perfectamente las necesidades tecnológicas que se requieren para poder brindar un diagnóstico y tratamiento oportuno. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV	X			UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	1.2. KV QUE CUBRA EL RANGO DE 40 A 120.	Entendemos que el ofertar un rango de kv superior a la solicitada no será motivo de descalificación. Se oferta equipo con un rango de 40 a 125 KV. ¿Es correcta nuestra asociación?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV	X			UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	1.3 CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O CONTINUA DE 3MA O MENOR A 60MA O MAYOR.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar el punto como: "Fluoroscopia 3 mA a 119 mA, Modo de funcionamiento Radioscopia pulsada y continua" lo que cumple y es superior con lo solicitado en la cédula ya que el equipo cuenta con el mismo rango de fluoroscopia tanto para continua como pulsada y es de esta manera como se encuentra en nuestros catálogos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
11	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV	X			UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	2.3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL ANODO DE 75KIU/MIN O MAYOR.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar el punto como: "Disipación térmica del ánodo: 91,000 HU/min" (equivalente a 91 KHU/min), siendo superior a lo solicitado en la ficha técnica es únicamente por temas de referencia ya que de esta manera aparece en nuestros catálogos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
12	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV	X			UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	3.2. SID DE 99CM O MAYOR DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE).	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar el punto como: "Distancia entre fuente y detector 107 cm" Siendo superior a lo solicitado en la ficha técnica es únicamente por temas de referencia ya que de esta manera aparece en nuestros catálogos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
13	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV	X			UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20° O PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar el punto como: "Intervalo de rotación: ± 12°" (total 24°). lo cual es superior a lo solicitado, es únicamente por temas de referencia ya que de esta manera aparece en nuestros catálogos, además se adjuntará imagen del movimiento. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes. Se aclara que los puntos 3.5, 3.6 y 3.7 deben decir: " 3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR. 3.6. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20° 3.7. PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG." dejando sin efecto "3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR. 3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20° O PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG."

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	ASISTENTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
14	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	4.1. ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar el punto como: "Profundidad de digitalización 16 bits." Cumpliendo con lo solicitado en la cédula es únicamente por temas de referencia ya que de esta manera aparece en nuestros catálogos ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
15	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	5.1. SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL O DSA	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar el punto como: "Angiografía por sustracción digital (Sust.) Durante el examen, las imágenes sin medio de contraste (máscara) se restan continuamente de las imágenes con medio de contraste y se muestran en el monitor. En función del flujo de medio de contraste, muestran el segmento vascular correspondiente sin superposición en tiempo real". Cumpliendo y siendo equivalente con lo solicitado en la ficha técnica, es únicamente por temas de referencia ya que de esta manera aparece en nuestros catálogos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
16	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	5.2. ROADMAPPING	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar el punto como: "Adquisición de imágenes: Sustracción / Roadmap" Cumpliendo y siendo equivalente con lo solicitado en la cédula, es únicamente por temas de referencia ya que de esta manera aparece en nuestros catálogos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
17	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	12. CONSOLA DE CONTROL MÓVIL	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar el punto como: "Clos Alpha consta de un sistema de arco en C y de un carro portamonitores. Ver Imagen Demostrando mediante la imagen la consola de control móvil, siendo equivalente con lo solicitado en la cédula, es únicamente por temas de referencia ya que de esta manera aparece en nuestros catálogos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa.
18	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		UNIDAD RX FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	14.3. AL MENOS 2 CUBIERTAS ESTERILIZABLES PARA TUBO Y ARCO.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Cubiertas estériles para arco en C, tubo de rayos X y detector plano ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando al menos sean dos cubiertas reusables o 20 cubiertas estériles desechables.
19	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		ECOCARDIOGRAFO 3D	24	4. RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA DE 2800B O MAYOR	Se solicita amablemente a la convocante a fin de no limitar la libre participación se nos permita ofertar nuestra tecnología utilizando nomenclatura propia de cada fabricante con 180 dB de rango dinámico. ¿Se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
20	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		ECOCARDIOGRAFO 3D	24	5.2. MODO M, M ANATÓMICO Y 2D SIMULTÁNEOS.	Se solicita amablemente a la convocante a fin de no limitar la libre participación se nos permita ofertar nuestra tecnología utilizando nomenclatura propia de cada fabricante con Modo M y modo M + Doppler color ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CONGREGACIÓN ADMINISTRATIVA	CONGREGACIÓN TÉCNICA	CONGREGACIÓN LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
21	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		ECOCARDIOGRAFO 3D	24		Se solicita amablemente a la convocante a fin de no limitar la libre participación se nos permita ofertar nuestra tecnología utilizando nomenclatura propia de cada fabricante con Doppler color, Doppler color de velocidad, Doppler tisular y Doppler tisular de energía ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
22	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV		X		ECOCARDIOGRAFO 3D	24		Se solicita amablemente a la convocante a fin de no limitar la libre participación se nos permita ofertar nuestra tecnología utilizando nomenclatura propia de cada fabricante con ajuste manual de línea base y PRF ¿Se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
23	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV	X			Tomografía 64 Cortes.	3	Desinstalación de Bienes Existentes	Durante la visita realizada a las Instalaciones del Hospital General de Acámbaro el día 08 de Mayo del 2023 se comentó que la desinstalación del equipo actual deberá correr por parte del Proveedor Adjudicado. Entendemos que dicha desinstalación será con fines de Destrucción y que los componentes se deberán embalar y poner a disposición de la Convocante dentro de las instalaciones del mismo Hospital donde fue desinstalado. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que el proveedor deberá desinstalar el equipo actualmente instalado considerando mantener las condiciones actuales, desarmar y proporcionar los elementos del tomógrafo siendo posicionados en algún tipo de estructura, protegido con plástico, etiqueta con información del elemento y con manobra de resguardo dentro del mismo hospital que será indicado por personal responsable de mantenimiento y/o administración.
24	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV	X			Tomografía 64 Cortes.	3	Protección Radiológica	Durante la visita realizada a las Instalaciones del Hospital General de Acámbaro el día 08 de Mayo del 2023 se comentó que el proveedor adjudicado puede aprovechar la infraestructura existente en tomas de protección radiológica, sin embargo, entendemos que en caso de que la actualización de tecnología provoque que dicha protección radiológica fuera insuficiente, será responsabilidad del Hospital y/o la Convocante reforzarla para cumplir con la normatividad vigente. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Las condiciones actuales de la protección radiológica son las adecuadas para el funcionamiento del equipo. Se aclara que si para la tecnología ofertada es insuficiente la protección radiológica actual de la sala, el proveedor adjudicado será el responsable de las adecuaciones para cumplir con la protección radiológica de acuerdo a la normatividad vigente, así como entregar la memoria analítica y levantamiento de niveles de radiación.
25	Siemens Healthcare Diagnostics S de RL de CV	X			Unidad RX Digital	1	Instalación Eléctrica	De acuerdo a las visitas realizadas a las Instalaciones del Hospital General de Uriangato así como al Hospital General de Valle de Santiago y tomando en cuenta el tiempo de vida recomendado para las Instalaciones eléctricas hospitalarias, se recomienda que, sin importar quien sea el proveedor adjudicado, se incluya dentro de la propuesta económica, la modernización de la Infraestructura Eléctrica incluyendo desde Transformador en Subestación, Cableado hasta Sala de Exploración, Alimentadores y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos. ¿Se acepta?	Los alcances de trabajo del proveedor adjudicado serán la desinstalación, empaque y reubicación dentro de la unidad médica del equipo que se encuentra actualmente instalado, así como la instalación del nuevo equipo. Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en cada una de las unidades médicas durante las visitas, son las definitivas y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes.
1	Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de CV.						1.3	Solicitamos a la convocante que para cumplir con este punto nos permita entregar como ORIGINAL el documento arrojado por la página del SAT impresa a color. ¿Se acepta?	Podrá presentarla.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Junta de aclaraciones

No. de Pregunta	Licitante	Carácter Administrativo	Carácter Técnico	Carácter Legal	Descripción del Bien	Partida	Punto	Pregunta	Respuesta
2.	Suministro para uso Médico y Hospitalari o, S.A. de C.V.	X					GENERAL PUNTO 3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar cartas de fabricante en copia simple, en caso de resultar adjudicado se deberá entregar original. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
3.	Suministro para uso Médico y Hospitalari o, S.A. de C.V.	X			Tomografía de 64 cortes	3	PUNTO II INCISO G LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA	Debido a la escasez de componentes electrónicos a nivel mundial y aunado a que los equipos ofertados son fabricados en el extranjero, solicitamos de la manera más atenta a la convocante para no limitar la libre participación ampliar el tiempo de entrega partida 03 Tomografía de 64 cortes, al 09 de diciembre de 2023 ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se aclara que para las partidas 1, 2, 3 y 34 del Anexo I, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día 09 de octubre de 2023; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para esta partida en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso g) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
4.	Suministro para uso Médico y Hospitalari o, S.A. de C.V.	X			Tomografía de 64 cortes	3	PUNTO II INCISO G LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA	En caso de que la pregunta anterior sea negativa, Debido a la escasez de componentes electrónicos a nivel mundial y aunado a que los equipos ofertados son fabricados en el extranjero, solicitamos de la manera más atenta a la convocante para no limitar la libre participación ampliar el tiempo de entrega partida 03 tomógrafo de 64 cortes, al 09 de octubre de 2023 ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se aclara que para las partidas 1, 2, 3 y 34 del Anexo I, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día 09 de octubre de 2023; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para esta partida en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso g) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
5	Suministro para uso Médico y Hospitalari o, S.A. de C.V.	X						Entendemos que el "Anexo AB" se debe de entregar firmado por el representante legal con todos los numerales ahí señalados y no debemos entregar una carta por cada numeral solicitado en dicho Anexo. ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación.
6	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARI O S.A. DE C.V.	X			tomógrafo de 64 cortes	3	1.9	Entendemos que esta característica podremos ofrecerla de acuerdo a nuestra tecnología como "Predict Scan" en el entendido a que se refiere a que el equipo deberá detectar automáticamente la llegada del medio de contraste a una Región Anatómica específica y empetar en automático el escaneo, ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
7	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARI O S.A. DE C.V.	X			16.4. APLICACIONES CARDIACAS, CUANTIFICACIÓN DE CALCIO EN CORONARIAS O SCORE DE CALCIO. ANÁLISIS DE CORONARIAS CON ELIMINACIÓN DE CUA TORÁXICA AUTOMÁTICA, SEGUIMIENTO Y EXTRACCIÓN DE CORONARIAS. EDICIÓN DE ZONAS DE ESTENOSIS. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN CARDIACA, ADQUISICIÓN SINCRONIZADA CON ECG.	3		Entendemos que con "Eliminación de Caja Torácica Automática", se refiere a que la región cardíaca se extraiga automáticamente de las imágenes torácicas. ¿Y podrá ser referenciado con descripción e imágenes que comprueben la extracción?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el instituto de salud pública del estado de guanajuato

junta de aclaraciones

no. de pregunta	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
8	suministrador para uso médico y hospitalario s.a. de c.v.	x			tomógrafo de 64 cortes	3	4.2. FACTOR DE PASO O PITCH EN EL RANGO DE 0.3 O MENOR A 1.5 O MAYOR	Entendemos que podemos ofrecer un rango de Pitch de 0.578 a 1.594, considerando que nuestro rango es mayor a lo solicitado 1.016 versus 1 y no afecta la aplicación clínica del mismo, ¿se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9	suministrador para uso médico y hospitalario s.a. de c.v.	x			MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV)	28	20. ACCESORIOS PARA USO ADULTO/PEDIATRICO:	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar los accesorios cables de ECG y SPO2 de acuerdo a nuestra propia tecnología ¿Se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
10	suministrador para uso médico y hospitalario s.a. de c.v.	x				TODAS LAS PARTIDAS	Página 9, III.2 Presentación de ofertas, Punto 1.16	Entendemos que en caso del licitante opte por entregar manuales, folletos y hojas técnicas solo de forma digital, únicamente se entregará impresa el índice de conformidad al anexo Q¿ Es Correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación. Podrá presentar impresas únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes, siempre y cuando presente de manera digital los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos para el equipo médico especializado, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.16.
11	suministrador para uso médico y hospitalario s.a. de c.v.	x				TODAS LAS PARTIDAS	Página 9, III.2 Presentación de ofertas, Punto 1.16	Solicitamos a la convocante que donde no sea suficiente el texto para comprobar las características solicitadas nos permita comprobar mediante imágenes en catálogos y Manuales ¿Se acepta?	El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
12	suministrador para uso médico y hospitalario s.a. de c.v.	x			UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	1.- GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA	Recomendamos a la convocante, con la finalidad de asegurar que el generador sea de alta frecuencia, se solicite a todos los licitantes que cuenten con una frecuencia mínima de 400 KHz. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13	suministrador para uso médico y hospitalario s.a. de c.v.	x			UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	1.2.- CON 500 mA O MAYOR	Considerando la potencia del generador, se sugiere se solicite una corriente mayor, que permita tener un equipo con mayor penetración en pacientes obesos, por lo que recomendamos a la convocante solicitar a todos los licitantes una corriente de al menos 630 mA.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
14	suministrador para uso médico y hospitalario s.a. de c.v.	x			UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	3.1.1.- PARA EL CASO DE COLUMNA INTEGRADA A LA MESA O SOPORTE A PISO. 3.1.1.1.- CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 145 CM O MAYOR. 3.1.1.2.- CON DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE 140 CM O MAYOR.	Entendemos que las características solicitadas pueden aplicar para un montaje ofertado tipo: Piso Techo o Piso Pared. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.

JUNTA DE ACLARACIONES

¿cuántos y en fines de semana el mismo horario.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el instituto de salud pública del estado de guanajuato

Junta de aclaraciones

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativo	carácter técnico	carácter legal	Descripción del bien	Partida	Junta	Pregunta	Respuesta
22	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	x			UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1		En el caso de nuestros equipos, requerimos de 65 KVA por equipo. En caso que el hospital no cuente con la capacidad eléctrica requerida entendemos que el Hospital será responsable de suministrar la capacidad necesaria en el trasfomador en cada uno de los sitios para conexión del equipo de Rayos X ¿es correcta nuestra apreciación?	En el Hospital General Uriangato se cuenta con transformador exclusivo para el servicio de Rayos X con una capacidad de 112.5 KVA En el Hospital General Valle de Santiago se cuenta con un transformador general con capacidad de 750 KVA. El licitante es responsable de suministrar, de ser el caso, el autotransformador para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada.
23	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	x			UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1		¿Será el Hospital el responsable de proporcionar la instalación eléctrica y voltajes, solicitados en guía mecánica para la conexión del equipo en sala? Y ¿Las líneas eléctricas existentes son dedicadas e independientes para cada equipo?	Se aclara que las condiciones y configuración de la Infraestructura observada en cada una de las unidades médicas durante las visitas, son las definitivas y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes. Se aclara que en la unidad médica Hospital General Uriangato existe suministro eléctrico independiente para el equipo de Rayos X con capacidad de 112.5 KVA. Se aclara que en la unidad médica Hospital General Valle de Santiago no existe suministro eléctrico independiente para el equipo de Rayos X ya que se encuentra conectado a transformador en general con capacidad de 750 KVA.
24	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	x			UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1		Entendemos que para los equipos que se van a retirar se reubicarán dentro de los hospitales y nos proporcionaran un área de resguardo para el equipo en caja cerrada. Se requiere un área segura de 3 x 3 m libres de humedad ¿es correcto nuestra apreciación.?	Es correcta su apreciación
25	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	x			UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX Y TOMOGRAFIA DE 64 CORTES	1 Y 3		¿Será el Hospital el responsable que cada sitio cumpla con los requerimientos ambientales tales como temperatura y humedad relativa, indicados en guías mecánicas del equipo?	Se aclara que el hospital es el responsable de cumplir con los requerimientos ambientales (temperatura y humedad relativa).
26	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	x			Tomógrafo de 64 cortes y Unidad de RX digital estudio de torax	Partidas 1 y 3		En el caso de los acabados, y que en la visita se entiende que deberá ser similar al existente. Se tendrá catálogo de conceptos de materiales instalados existente en el sitio. Nos será proporcionado para considerarlo? En caso de que el acabado, material etc. Se encuentre discontinuado se podrá colocar un similar o como se deberá proceder?	Se aclara que no se cuenta con un catálogo de conceptos. El licitante será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros y piso por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes o de acuerdo a las indicaciones del Hospital.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	CONDUCTA ADMINISTRATIVA	CONDUCTA TÉCNICA	FACTIBILIDAD LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
27	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	X		Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Indico a) Visita a las Instalaciones	En caso de ser necesario la colocación de protección radiológica ¿Quién será el responsable de entregar la memoria analítica y levantamiento de niveles de radiación?	Se aclara que si para la tecnología ofertada es insuficiente la protección radiológica actual de la sala, el proveedor adjudicado será el responsable de las adecuaciones para cumplir con la protección radiológica de acuerdo a la normatividad vigente, así como entregar la memoria analítica y levantamiento de niveles de radiación.
28	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	X		Unidad rx digital estudios de tórax y Tomógrafo de 64 cortes	1 y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Indico a) Visita a las Instalaciones	Dado que ya hay equipos instalados entendemos que las salas ya tienen protección radiológica, ¿Tienen las especificaciones del blindaje? ¿Se tienen los levantamientos de niveles de radiación?	Se proporciona en esta Junta de aclaraciones memoria analítica del Hospital General de Acámbaro y del Hospital General de Uruapan. En cuanto al Hospital General de Valle de Santiago la información con la que se cuenta es la derivada de la visita a las instalaciones. En el Hospital General Acámbaro se cuenta con concreto armado, con 20 cm de espesor, con una capacidad de resistencia de 250 kg/cm2.
29	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	X		Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Indico a) Visita a las Instalaciones	¿La losa de la sala está preparada para recibir el peso del equipo de aproximadamente 2.8 TON? Caso contrario, ¿Quién será responsable del refuerzo de la losa?	Es responsabilidad del proveedor realizar las adecuaciones u obra civil necesarias para el correcto funcionamiento y operatividad del equipo a instalar, se podrían hacer las adecuaciones pertinentes por cada proveedor siempre y cuando se respeten los acabados actuales o similares con los que cuenta cada unidad médica.
30	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	X		Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Indico a) Visita a las Instalaciones	De acuerdo a la visita al área se nos informó que el hospital será responsable de aire acondicionado dedicado para el equipo de tomografía y el área de UPS ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que el área destinada para colocar el UPS será en el cuarto de máquinas de acuerdo a la visita a las instalaciones. En caso de que la tecnología ofertada del UPS requiere de un sistema de enfriamiento por la capacidad calorífica que genere el equipo, el licitante adjudicado será el responsable de suministrar el sistema de enfriamiento.
31	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	X		Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Indico a) Visita a las Instalaciones	De acuerdo a la visita al área se informó que la única opción para la instalación del UPS del equipo de tomografía y el transformador es dentro de la subestación, considerando un área de 3 x 4 m para su instalación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que el UPS será instalado en el cuarto de máquinas, de acuerdo a la visita realizada en el Hospital General Acámbaro.
32	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.	X		Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Indico a) Visita a las Instalaciones	Los requerimientos eléctricos solicitados en guía mecánica para la conexión del equipo en sala ¿Quién será el responsable de proporcionar la instalación?	Se aclara que el proveedor adjudicado es responsable de suministrar los requerimientos eléctricos para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada. Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, es la definitiva y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerado por parte de los licitantes.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Junta de Aclaraciones

No. de Pregunta	Licitante	Carácter Administrativo	Carácter Técnico	Carácter Legal	Descripción del Bien	Partida	Punto	Pregunta	Respuesta
33	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X		Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN (ver el a) Visita a las instalaciones	Para el funcionamiento de equipo se requiere una alimentación eléctrica trifásica a 480 VAC (3 líneas, neutro y tierra física), ¿la instalación eléctrica se proporcionará a pie de sala?	Se aclara que el proveedor adjudicatario es responsable de suministrar los requerimientos eléctricos para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada. Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, es la definitiva y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerado por parte de los licitantes.
34	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X		Tomógrafo de 64 cortes y unidad de RX DIGITAL ESTUDIO DE TORAX	1 y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN (ver el a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita, se nos informó que el área tiene tierra física independiente para los equipos. Entendemos que cualquier situación con la tierra física será responsabilidad del hospital corregirla. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se hace la aclaración que en el Hospital General Acámbaro la conexión a tierra del equipo actualmente instalado se encuentra conectado a la malla general de tierra del Hospital. Se hace la aclaración que en el Hospital General Uriangato la conexión a tierra del equipo actualmente instalado es independiente. Se hace la aclaración que en el Hospital General Valle de Santiago la conexión a tierra del equipo actualmente instalado se encuentra conectado a la malla general de tierra del Hospital. Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en cada una de las unidades médicas durante las visitas, son las definitivas y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes. En caso de requerir alguna tierra adicional y/o electrónica, deberá ser considerada en su propuesta técnico-económica.
35	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X		tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN (ver el a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita se nos informó que el área de interpretación de tomografía actual será la misma que se utilizara para el nuevo equipo, ¿Es correcta nuestra interpretación?	Es correcta su apreciación.
36	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X		tomógrafo de 64 cortes y UNIDAD DE RX DIGITAL ESTUDIO DE TORAX	PARTIDA 1 Y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN (ver el a) Visita a las instalaciones	Se requiere un par de nodos de red, ¿se tienen disponibles en sala e interpretación? En caso de ser necesario se habiliten ¿Entendemos que el hospital será responsable de proporcionarlo?	Se aclara que las conexiones de red deberán ser punto a punto y que el proveedor será el responsable del suministro e instalación y en caso de ser necesario obra civil considerando dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes. Se aclara que en el Hospital General Acámbaro no se encuentra habilitado el espacio para los nodos, sin embargo se pueden habilitar. Se aclara que en el Hospital General Uriangato se encuentra habilitado el espacio para los nodos. Se aclara que en el Hospital General Valle de Santiago se encuentra habilitado el espacio para los nodos.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativo	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio a) Visita a las instalaciones	PREGUNTA	RESPUESTA
37	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.		x		tomógrafo de 64 cortes y UNIDAD DE RX DIGITAL ESTUDIO DE TORAX	PARTIDAS 1 Y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio a) Visita a las instalaciones	Del equipo existente si algún elemento es utilizable y servible para la instalación del equipo a instalar se puede utilizar (interruptores, cableado, transformador, canalización existente etc.) ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que se podrán reutilizar los elementos servibles, siempre y cuando no afecte el funcionamiento de su tecnología ofertada.
38	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.		x		tomógrafo de 64 cortes y UNIDAD DE RX DIGITAL ESTUDIO DE TORAX	PARTIDAS 1 Y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio a) Visita a las instalaciones	Favor de indicarnos en cada área ¿Cuál es la distancia desde el site a la sala de escaneo?	En el Hospital General de Acámbaro la distancia entre el área de Site y sala del equipo es de 55 metros. En el Hospital General Uriangato la distancia entre el Site y la sala del equipo es de 60 metros. En el Hospital General de Valle de Santiago la distancia entre el área de Site y sala del equipo es de 85 metros.
39	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.		x		tomógrafo de 64 cortes y UNIDAD DE RX DIGITAL ESTUDIO DE TORAX	PARTIDAS 1 Y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio a) Visita a las instalaciones	Favor de indicarnos ¿Cuál es la distancia desde la subestación eléctrica a la sala de escaneo para cada área?	En el Hospital General de Acámbaro la distancia entre el área de Subestación y sala del equipo es de 75 metros. En el Hospital General Uriangato la distancia entre el área de Subestación y la sala del equipo es de 133 metros. En el Hospital General de Valle de Santiago la distancia entre el área de Subestación y sala del equipo es de 220 metros.
40	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.		x		tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio a) Visita a las instalaciones	Se entiende que la instalación eléctrica desde subestación eléctrica tiene trayectoria entre losa y plafón, es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación.
41	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.		x		tomógrafo de 64 cortes y UNIDAD DE RX DIGITAL ESTUDIO DE TORAX	PARTIDAS 1 Y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a las visitas realizadas, se observaron fisuras y/o golpes en muros, detalles de puertas y manijas, etc.; ¿Se harán mejoras? ¿Quién será responsable de los trabajos de mejoras en cada sala?, ¿Cuál será el alcance de los trabajos?	Se aclara que de acuerdo a la visita realizada a las unidades médicas, la reparación de las condiciones de la Infraestructura actual, será absorbida por el ISAPEG. Se aclara que el proveedor adjudicado será el responsable de la reparación de cualquier daño a la infraestructura de los hospitales ocasionadas por maniobras o trabajos.
42	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.		x		tomógrafo de 64 cortes y UNIDAD DE RX DIGITAL ESTUDIO DE TORAX	PARTIDAS 1 Y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita realizada, se observó que hay canalizaciones en cada sala, ¿en caso de requerir trayectorias diferentes a las existentes de quien será responsabilidad las canalizaciones para el equipo nuevo? ¿Se pueden hacer las ranuras necesarias en piso con la condicionante que se suministre e instale un piso similar al existente? ¿Se acepta?	Es responsabilidad del proveedor realizar las adecuaciones u obra civil necesarias para el correcto funcionamiento y operatividad del equipo a instalar, se podrán hacer las adecuaciones pertinentes por cada proveedor siempre y cuando se respeten los acabados actuales o similares con los que cuenta cada unidad médica.
43	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.		x		tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio a) Visita a las instalaciones	Para el caso de almacenaje del equipo de tomografía que se va a desinstalar, ¿se tendrán las ruedas propias para su movilidad?	Se aclara que el equipo no cuenta con las ruedas.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 [CAGEG-021/2023] PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	TIPO DE LICITANTE	CARACTER ADMINISTRATIVA	CARACTER TECNICO	CARACTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
44	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.		X		Tomógrafo de 64 cortes	PARTIDA 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio al Visita a las Instalaciones	De acuerdo a las visitas se entiende que se podrá reutilizar la instalación eléctrica, canalizaciones, focos rojos e instalaciones en general que puedan ser útiles para la instalación del nuevo equipo, ¿es correcto?	Se aclara que se podrán reutilizar los elementos servibles, siempre y cuando no afecte el funcionamiento de su tecnología ofertada.
45	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.		X		Tomógrafo de 64 cortes	PARTIDA 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio al Visita a las Instalaciones	Cuántos con planos actualizados del área o instalaciones que pasen o intervienen en las salas ¿pueden proporcionarnos copia de estos?, para en caso de requerir perforar o hacer algún ajuste las instalaciones se tenga conocimiento de sus trayectorias.	Como parte del desarrollo de la presente Junta de aclaraciones se entregan los planos correspondientes de los lugares de instalación de las partidas 1 y 3.
46	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.		X		tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio al Visita a las Instalaciones	En el caso de nuestros equipos, ¿requerimos de 400 volts 100 KVA para el equipo. En caso que el hospital no cuente con la capacidad eléctrica requerida, Entendemos que el hospital será responsable de suministrarla para conexión del equipo de tomografía?	Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes.
47	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.		X		Tomógrafo de 64 cortes y Unidad de RX digital estudio de torax	Partidas 1 y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio al Visita a las Instalaciones	Se entiende que la medida de la milla existente tiene lo necesario para el hospital y no se toca ni se cambia, ¿es correcto?	Es correcta su apreciación.
48	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.		X		Tomógrafo de 64 cortes y Unidad de RX digital estudio de torax	Partidas 1 y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio al Visita a las Instalaciones	Se requiere del anclaje del equipo en piso, ¿Qué tipo de piso se tiene? ¿Espesor de piso?, ¿resistencia del piso? En caso de requerir un mejoramiento del piso para anclar el equipo ¿Quién será responsable?	Es responsabilidad del proveedor realizar las adecuaciones u obra civil necesarias para el correcto funcionamiento y operatividad del equipo a instalar, se podrán hacer las adecuaciones pertinentes por cada proveedor siempre y cuando se respeten los acabados actuales o similares con los que cuenta cada unidad médica. En el Hospital General Acimbaro se cuenta con concreto armado, con 20 cm de espesor, con una capacidad de resistencia de 250 kg/cm2. En el Hospital General Valle de Santiago el tipo de piso es Firme, con 20 cm de espesor, con una capacidad de resistencia de 10 toneladas. En el Hospital General Uriangato el tipo de piso es Firme, con 12 cm de espesor.
49	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.		X		Tomógrafo de 64 cortes y Unidad de RX digital estudio de torax	Partidas 1 y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inicio al Visita a las Instalaciones	El licitante será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros y piso por causas de manobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes o afectar la operatividad del área, deberá considerar la sustitución total de pintura en muros y/o pisos completos.	El licitante será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros y piso por causas de manobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes o de acuerdo a las indicaciones del Hospital.

JUNTA DE ACLARACIONES

NÚMERO DE PREGUNTA	IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE	MODALIDAD DE ADMINISTRATIVA	CLASIFICACIÓN TECNOLÓGICA	CONVOCATORIA LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
50	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.	X			Tomógrafo de 64 cortes y Unidad de RX digital estudio de torax	Partidas 1 y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN inicio a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita realizada, ¿La línea eléctrica existente es dedicada e independiente para el equipo?	Se hace la aclaración que en el Hospital General Acámbaro existe suministro eléctrico independiente para el equipo de Tomografía Se hace la aclaración que en el Hospital General Uriangato existe suministro eléctrico independiente para el equipo de Rayos X Se hace la aclaración que en el Hospital General Valle de Santiago no existe suministro eléctrico independiente para el equipo de Rayos X
51	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.	X			Tomógrafo de 64 cortes y Unidad de RX digital estudio de torax	Partidas 1 y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN inicio a) Visita a las instalaciones	Para el ingreso del equipo a la sala, ¿Quién será responsable del retiro y reinstalación de puertas, en caso de ser necesario?	En caso de ser necesario retirar marcos y puertas de los locales, el proveedor será el responsable y deberá considerar estas maniobras en su propuesta.
52	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.	X			tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN inicio a) Visita a las instalaciones	Para el caso de almacenaje del equipo de tomografía que se va a desinstalar, ¿se tendrán las ruedas propias para su movilidad?	Se aclara que el equipo no cuenta con las ruedas.
53	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.	X			tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN inicio a) Visita a las instalaciones	¿Las unidades cuentan con un área de resguardo para el equipo en cajas cerradas? Se requiere un área segura de al menos 5 x 4 m con una altura mínima de 2.5 m libre de humedad.	Se aclara que de acuerdo a la visita realizada a la unidad médica, los licitantes revisaron las dimensiones de las áreas pertinentes para el trabajo de maniobras y resguardo, considerando los trabajos necesarios para el mismo.
54	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.	X			Tomógrafo de 64 cortes y Unidad de RX digital estudio de torax	Partidas 1 y 3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN inicio a) Visita a las instalaciones	Para evitar ramurar muros y dañar protección radiológica, ¿se aceptan instalaciones visibles en muros?	Se podrán ofertar instalaciones sobremuro, siempre y cuando no afecten el funcionamiento del área ni el flujo del personal y del mobiliario rodable, deberá respetar los acabados actuales o similares con los que se cuenta en la unidad médica
55	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.	X			UNIDAD DE RX DIGITAL ESTUDIO DE TORAX	PARTIDAS 1	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN inicio a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a las vistas se entiende que se podrá reutilizar la instalación eléctrica, canalizaciones, focos rojos e instalaciones en general que puedan ser útiles para la instalación del nuevo equipo, ¿es correcto?	Es correcta su apreciación
56	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO RIO S.A. DE C.V.	X			UNIDAD DE RX DIGITAL ESTUDIO DE TORAX	PARTIDA 1	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN inicio a) Visita a las instalaciones	Cuentan con planos actualizados del área e instalaciones que pasan o intervienen en las salas ¿pueden proporcionarnos copia de estos?, para en caso de requerir perforar o hacer algún ajuste las instalaciones se tenga conocimiento de sus trayectorias	Como parte del desarrollo de la presente junta de aclaraciones se entregan los planos correspondientes de los lugares de instalación de las partidas 1 y 3.

JUNTA DE ACLARACIONES

ORDEN DE PREGUNTA	LICITANTE	CARACTER ADMINISTRATIVA	CARACTER TECNICO	CARACTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	X			UNIDAD DE RX DIGITAL ESTUDIO DE TORAX	PARTIDAS 1	II. INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION inicio a) Visita a las Instalaciones	Para el soporte de la columna de Rayos X, se requiere un riel que se fijará a la losa, por lo que se abrirá el plafón, ¿se puede modificar de tal manera que se realice un cajillo en plafón? ¿Quién será responsable de dichos trabajos? ¿Puede instalarse plafón corrido o deberá ser similar al existente?	Podrán ofertar un cajillo de tablaroca corrido en el área de basculación del equipo, siempre y cuando conserve las demás condiciones de plafón y luminarias. Es responsabilidad del proveedor realizar las adecuaciones u obra civil necesarios para el correcto funcionamiento y operatividad del equipo a instalar, se podrán hacer las adecuaciones pertinentes por cada proveedor siempre y cuando se respeten los acabados actuales o similares con los que cuenta cada unidad médica.
57	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	X			Tomógrafo de 64 cortes y Unidad de RX digital estudio de torax	Partidas 1 y 3	II. INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION inicio a) Visita a las Instalaciones	¿Es necesario un paro de emergencia y arrancador para cada equipo de Rayos X?	Es correcta su apreciación, cada equipo deberá contar con un sistema de paro de emergencia.
58	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.						1.6 DOCUMENTOS LEGALES	SOLICITAN COPIA DE TODAS LAS MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA, CONSIDERANDO QUE ES UNA LICITACION PRESENCIAL Y NUESTRA REPRESENTADA TIENE VARIAS MODIFICACIONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLAMENTE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el punto 1.6 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la licitación.
1	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	X						OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL- VIGENTE Y POSITIVA. TODA VEZ QUE ACTUALMENTE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE TAN SOLO 24 HR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DICHA OPINION SE ADJUNTE CON UNA FECHA MAXIMO 5 DIAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUUESTAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD	La Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, se solicita con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación, por lo que podrá presentarse con fecha de al menos cinco días naturales anteriores al acto de apertura.
2	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	X					1.7 OPINION CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		Se aclara que el certificado FC8 será entregado únicamente para la partida 17 "ESTERILIZADOR DE VAPOR DENTAL 21 LITROS".
3	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	X					FC8: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ASME PARA RECIPIENTES SOMETIDOS A PRESIÓN CON FECHA DE VENCIMIENTO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR PARA QUE PARTIDAS APLICA ESTE DOCUMENTO.	Se aclara que en la presente Junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo J BIS (requisitos de calidad), dejando sin efecto el Anexo J.
	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	X			TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS			Se solicita amablemente a la convocante que derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podrán ser verificadas por el área usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta técnica, como condición de firmar el contrato, se acepta?	Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e Impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
1	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	X					Numeral III punto 1.18 FC1, FC5, FC6 Y FC7		
	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.				ESFIGNOMANOMETR O ANEROIDE PORTA PED UNIV			DICE: PEDESTAL CON ALTURA AJUSTABLE ENTRE 90 Y 110 CM., se PREGUNTA: Solicita amablemente a la convocante poder odotar: PEDESTAL CON ALTURA FIJA ENTRE 110-120 CM Toda vez que esta característica no afecta en el funcionamiento del bien, Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	X				16	5.2		

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	INNOVACION	CARACTER ADMINISTRATIVO	CARACTER TECNICO	CARACTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
11	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	33	8.4.	Dice: CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO. 9. SISTEMA PLEGABLE. PERFIL TUBULAR. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar ARO IMPULSOR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encajarse el bien. Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	EYM SOLUTIONS S.A DE CV							PREGUNTA: DEBEREMOS ENTENDER LA PROVEEDURIA QUE SE DEBERA INTEGRAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS LEGALES CON LOS CUALES SE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN Y PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE O APODERADO, AGREGANDO COPIA SIMPLE DE ESTOS MISMOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO?	Es correcta su apreciación, los originales o copias certificadas serán devueltos en el mismo acto, ya que son únicamente para cotejo.
2	EYM SOLUTIONS S.A DE CV						III PRESENTACION DE OFERTAS, PUNTO 1.6 EN EL CASO DE PERSONAS MORALES.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR Y ENTREGAR PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TOUCHSCREEN DE 10.1 PULGADAS PARA NAVEGACION DE LOS CONTROLES DEL SISTEMA, LO CUAL NO REPERCUTE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI EN ESPACIO PARA PODER OPERAR EL PANEL. SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
3	EYM SOLUTIONS S.A DE CV		X		ECOCARDIOGRAFO 3D	34	PUNTO 46. QUEMADOR DE DISCO CD-R/DVD PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES INTEGRADO AL EQUIPO. CON PUERTO USB PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES.	DEBERAMOS ENTENDER LA PROVEEDURIA QUE SE DEBERA OFERTAR PARA ESTE PUNTO QUEMADOR DE DISCO CD-R/DVD PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES INTEGRADO AL EQUIPO Ó CON PUERTO USB PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES. ES CORRECTO?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
4	EYM SOLUTIONS S.A DE CV		X		ECOCARDIOGRAFO 3D	34	PUNTO 46. QUEMADOR DE DISCO CD-R/DVD PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES INTEGRADO AL EQUIPO. CON PUERTO USB PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES.	EN VITUD DE QUE SE SOLICITA PARA ESTE EQUIPO LICENCIAMIENTO DICOM PARA ALMACENAMIENTO, IMPRESIÓN Y ENVIO DE IMÁGENES ENTRE OTROS; SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE PARA PODER CUBRIR ESTE PUNTO SE PUEDA OFERTAR UNIDAD DE CD-R/DVD PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES, EXTERNO; ADICIONAL AL PUERTO USB PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES QUE SI VIENE INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO. SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
			X		ECOCARDIOGRAFO 3D			UNIDAD RX DIGITAL CON ESTUDIOS DE TÓRAX	Es correcta su apreciación.
								Puntos: 3.1.2.- PARA EL CASO DE SOPORTE A TECHO: 3.1.2.1.- DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE 170 CM O MAYOR. 3.1.2.2.- DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 240 CM O MAYOR.	
								Pregunta: Entendemos que para los puntos 3.1.2, 3.1.2.1 y 3.1.2.2, se deberá referenciar como no aplica en caso de ofertar soporte mediante rieles a piso como se indica en los puntos 3.1.3 y 3.1.3.1.	
								¿Es correcto?	
								6.3.- CON ALTURA AJUSTABLE DE 60 CM O MENOR A 80 CM O MAYOR. Solicitamos se permita ofertar una altura ajustable de 63 a 88 cm considerando que es un rango superior, sin que esto sea obligatorio para el resto de los licitantes, ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	Electrónica y Medicina, S.A.		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	3.1.2.- PARA EL CASO DE SOPORTE A TECHO: 3.1.2.1.- DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE 170 CM O MAYOR 3.1.2.2.- DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 240 CM O MAYOR.		
2	Electrónica y Medicina, S.A.		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	6.3		

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el instituto de salud pública del estado de guanajuato

Junta de aclaraciones

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Clínico	Descripción del bien	Partida	Punto	Pregunta	Respuesta
3	Electrónica y Medicina, S.A.					Partida 2 y Partida 3	g) Lugar y tiempo de entrega	Derivado del desabasto de los semiconductores, que ha ocasionado un retraso considerable en la fabricación de equipo médico, ponemos a su consideración una ampliación de 150 días, aunado a qué piden que se entregue el equipo funcionando de acuerdo con el Anexo M, ¿Se acepta?	Se aclara que para las partidas 1, 2, 3 y 34 del Anexo I, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día 09 de octubre de 2023, dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para esta partida en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para los demás partidos deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso g) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
4	Electrónica y Medicina, S.A.		X			Partida 2 y Partida 3	III.1. FCL: Carta del Fabricante	Pregunta: Solicitamos se permita entregar carta de apoyo de la FIUAL del Fabricante, en nuestro caso de Estados Unidos, dando cumplimiento a los compromisos solicitados. ¿Se acepta?	Podrá presentar la carta solicitada con la firma de la filial del fabricante, siempre y cuando adjunten el documento de respaldo del fabricante que acredite a la filial.
5	Electrónica y Medicina, S.A.					Todas las Partidas	III.1. FCL: Copia del Registro Sanitario, 1 y 2	Pregunta: Solicitamos se permita entregar comprobante de solicitud de modificación del Registro Sanitario, ya que a la fecha COFEPRIS se encuentra retrasada en la entrega de las actualizaciones de los registros sanitarios y/o modificaciones. ¿Se acepta?	En caso de que el registro sanitario o modificación de registro no estén vigentes y presente prórroga del registro sanitario emitido por la COFEPRIS, ésta deberá coincidir con las características solicitadas del producto, con la marca, modelo, fabricante y procedencia y dicho documento tendrá que acompañarse de la copia legible del registro sanitario de origen, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.18 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
6	Electrónica y Medicina, S.A.		X			Todas las Partidas		Pregunta: Solicitamos se permita referenciar el nombre de software o aplicación que maneja cada fabricante, ya que en algunos casos no se podrá referenciar textualmente de acuerdo con la especificación solicitada, en el entendido que se estará dando cumplimiento con lo solicitado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
7	Electrónica y Medicina, S.A.		X				S/P	Pregunta: Entendemos que el equipo a ofertar debe tener la capacidad de manejar un rango (continuo) ya sea en fluoroscopia pulsada o fluoroscopia continua iniciando en 3 mA o menor hasta 60 mA o mayor. ¿Es correcto?	En caso de que no pueda referenciarlo, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
8	Electrónica y Medicina, S.A.		X			2	1.3	Pregunta: Entendemos que, para garantizar la cobertura del tamaño del Detector a ofertar, se deberá referenciar la imagen reconstruida, es decir, demostrar la reconstrucción de la imagen cuadrada y de acuerdo con el tamaño del Detector a ofertar. ¿Es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
			X			2	4.3		Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 [CAGEG-021/2023] para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Junta de Aclaraciones

No. de Pregunta	Licitante	Carácter Alternativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	Descripción del Bien	Partida	Punto	Pregunta	Respuesta
9	Electrónica y Medicina, S.A.		X		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	7.4	Solicitamos poder ofertar el nombre de cada casa comercial en lo general, ya que la corrección de metal se utiliza para cualquier procedimiento donde pueda haber algún metal. Lo anterior no limita la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación. En caso de que no pueda referenciarlo, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
10	Electrónica y Medicina, S.A.		X		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	7.8	Solicitamos poder ofertar el software o tecnología de cada casa comercial para dar cumplimiento con la reducción de movimiento. Lo anterior no limita la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación. En caso de que no pueda referenciarlo, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
11	Electrónica y Medicina, S.A.		X		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	7.9	Solicitamos poder ofertar el software o programa anatómico de cada casa comercial para dar cumplimiento con la reducción de dosis para pacientes pediátricos. Lo anterior no limita la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación. En caso de que no pueda referenciarlo, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
12	Electrónica y Medicina, S.A.		X		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	9	Al parecer existe un error de transcripción y lo que solicitan es la licencia DICOM MPPS, con la que se puede enviar este tipo de información al PACS. ¿Es correcto?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
13	Electrónica y Medicina, S.A.		X		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	10	Pregunto. Entendemos que la unidad de grabación CD-R O DVD en formato DICOM, deberá estar integrada al equipo. ¿Es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
14	Electrónica y Medicina, S.A.		X		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	14.3	Por temas de seguridad en el manejo del paciente, solicitamos se permita ofertar fundas estériles desechables. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando al menos sean dos cubiertas reusables o 20 cubiertas estériles desechables.
15	Electrónica y Medicina, S.A.		X		TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	2	Entendemos que el número de filas del detector o elementos de rotación deben ser de 64. ¿Es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto.

licitación PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativo	Carácter Técnico	Carácter Legal	Descripción del Bien	Partida	Punto	Pregunta	Respuesta
16 S.A.	Electrónica y Medicina,	X			TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	15.4	Solicito amablemente el poder referenciar este punto de forma pictográfica. ¿Se acepta?	El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa.
17 S.A.	Electrónica y Medicina,	X			TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	16.14	Por cuestión de referenciación en la literatura, solicito amablemente el poder referenciar como: "Facilitación de fly-through para el colon, la tráquea y los vasos; Definir ruta de fly-through; Modo de navegación manual; Guardado del resultado de la navegación". Con lo que se permite la evaluación de la broncoscopia. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
18 S.A.	Electrónica y Medicina,	X			TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	Constancia de Visita Partida 3	De acuerdo con la constancia emitida en la visita, entendemos que, para la desinstalación y resguardo del equipo de tomografía actualmente instalado en el Hospital General de Acámbaro, se deberá considerar únicamente una estructura de madera protegida con plástico para resguardar el equipo. ¿Es correcto?	Se aclara que el proveedor deberá desinstalar el equipo actualmente instalado considerando mantener las condiciones actuales, desarmar y proporcionar los elementos del tomógrafo siendo posicionados en algún tipo de estructura, protegido con plástico, etiqueta con información del elemento y con manobra de resguardo dentro del mismo hospital que será indicado por personal responsable de mantenimiento y/o administración.
19 S.A.	Electrónica y Medicina,	X			TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3		Favor de aclarar cuál será el lugar de resguardo del equipo de tomografía instalado en el Hospital General de Acámbaro. En caso de que el resguardo sea fuera de la unidad, ¿Quién será responsable del traslado?	Se aclara que el proveedor deberá desinstalar el equipo actualmente instalado considerando mantener las condiciones actuales, desarmar y proporcionar los elementos del tomógrafo siendo posicionados en algún tipo de estructura, protegido con plástico, etiqueta con información del elemento y con manobra de resguardo dentro del mismo hospital que será indicado por personal responsable de mantenimiento y/o administración.
20 S.A.	Electrónica y Medicina,	X			TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3		Solicitamos por favor a la convocante nos facilite el plano arquitectónico del Hospital General de Acámbaro	Como parte del desarrollo de la presente junta de aclaraciones se entregan los planos correspondientes de los lugares de instalación de las partidas 1 y 3.
21 S.A.	Electrónica y Medicina,	X			TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3		Favor de aclarar si la convocante proveerá del área física necesaria o en su caso la adecuación de algún área para la instalación de la UPS de soporte para el equipo de Tomografía, así como el miniplant que dicha UPS requiere debido al calor producido. Favor de aclarar.	Se aclara que el área destinada para colocar el UPS será en el cuarto de máquinas de acuerdo a la visita a instalaciones. En caso de que la tecnología ofertada del UPS requiera de un sistema de enfriamiento por la capacidad calorífica que genere el equipo, el licitante adjudicado será el responsable de suministrar el sistema de enfriamiento.
22 S.A.	Electrónica y Medicina,	X			TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	17.6.	Para asegurar un mejor funcionamiento y mantenimiento del sistema UPS, es recomendable considerar que el área donde se encuentre instalado cuente con aire acondicionado. Favor de aclarar que parte sera responsable de gestionar el miniplant para el sistema UPS.	Se aclara que el área destinada para colocar el UPS será en el cuarto de máquinas de acuerdo a la visita a instalaciones. En caso de que la tecnología ofertada del UPS requiera de un sistema de enfriamiento por la capacidad calorífica que genere el equipo, el licitante adjudicado será el responsable de suministrar el sistema de enfriamiento.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LIANTANTE	CAARCTER ADMINISTRATIVA	CAARCTER TÉCNICO	CAARCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESUESTA
23	Electrónica y Medicina, S.A.		X		TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	18		Se aclara que el licitante es responsable de suministrar los requerimientos eléctricos para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada. Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, es la definitiva y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes.
1	INTEGRACI ON TECNOL OGICA HOSPITALA RIA, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA ADULTO	14	3.4	Favor de aclarar si será la convocante el responsable de proporcionar la alimentación eléctrica a pie de sala requerida por el equipo de tomografía o será el proveedor el que requiera colocar un autotransformador para alimentar el equipo.	El licitante es responsable de suministrar, de ser el caso, el autotransformador para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada.
2	INTEGRACI ON TECNOL OGICA HOSPITALA RIA, S.A. DE C.V.		X		UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX	1		SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR ALTURA VARIABLE DE 58 A 88.7 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHON) LO CUAL SE CONSIDERA COMO MINIMA TOLERANCIA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE NO AFECTA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	PROVEEDU RIA DE PRODUCTO S Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV		X	X		TODAS	CAPITULO III	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ASIGNE UNA FECHA ADICIONAL PARA LA VISITA EN LA PARTIDA 1 UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX. ¿SE ACEPTA?	Apegarse a lo establecido en el apartado II. Información específica de la Licitación, inciso a) Visita a instalaciones.
2	PROVEEDU RIA DE PRODUCTO S Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV							Solicitamos a la convocante, que las cartas originales requeridas, las podamos presentarlas en copia simple acompañadas con carta del licitante donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar las originales a la firma del contrato, ¿se acepta nuestra solicitud?	Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e Impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPG previo al acto de fallo de la presente licitación.
1	PROVEEDU RIA DE PRODUCTO S Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV							Debido a la escasez en algunos componentes e insumos médicos, esto derivado de la pandemia, solicitamos una ampliación en el tiempo de entrega en caso de resultar adjudicados a más tardar el 02 de octubre del 2023 ¿se acepta nuestra solicitud?	Se aclara que para las partidas 1, 2, 3 y 34 del Anexo I, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día 09 de octubre de 2023; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para esta partida en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso g) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
2	Medico Siller S. A. de C. V.		X			TODAS	CAPITULO II	Solicitan 6.1.- TABLERO DE LA MESA CON RECORRIDO LONGITUDINAL +/-40 CM O MAYOR. "	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	Medico Siller S. A. de C. V.					1	6.1	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo con un recorrido longitudinal de 77 cm totales, lo cual no afecta en el desempeño del estudio. ¿Se acepta?	

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
1	DEWIMED, S.A.		x		Microscopio para exploración ORL	5	3.1	El punto hace mención a una óptica acromática. Las lentes acromáticas están diseñadas para concentrar dos longitudes de onda (típicamente rojos y azules) en un único plano focal. En cambio, las lentes apocromáticas están diseñadas para concentrar tres longitudes de onda (típicamente rojos, verdes, y azules) en el mismo plano focal. Entendemos que ofrecer una óptica apocromática como mejora tecnológica no es motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	DEWIMED, S.A.		x		Partidas de Instrumental	7, 8, 9 y 10	S/P	Conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación del día 01 de octubre de 2003 y en la que se dio a conocer la décima cuarta actualización del cuadro básico y catálogo de instrumental y equipo médico: modificaciones de instrumental, se cita: En el caso de instrumental, se acepta una variación de +/- 10% en las medidas. De acuerdo con lo anterior, se solicita a la convocante, considerar dichas tolerancias de +/- 10% en las medidas generales del instrumental siempre y cuando no afecte su funcionalidad. ¿Se acepta?	Para el instrumental médico se acepta una variación de +/- 10% en las medidas de acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 01 de octubre de 2003, de acuerdo a lo establecido en el apartado II. Información específica de la Licitación, inciso g) Lugar y tiempo de entrega de la presente licitación.
3	DEWIMED, S.A.		x		Set de Instrumental de sutura	10	6	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente, dimensiones: 26 x 26 x 5 cm. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	DEWIMED, S.A.		x		Carro Camilla Adulto	14	5	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un ancho de la superficie de reposo de 620 mm, esto no hace que la funcionalidad del bien se vea afectado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	DEWIMED, S.A.		x		Carro Camilla Adulto	14	6	Con el fin de promover la libre participación, se solicita a la convocante nos permita ofertar un ancho total (exterior) de 760 mm que son características propias de fabricante, esto no hace que la funcionalidad del bien se vea afectado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	DEWIMED, S.A.		x		Estuche de diagnóstico básico	19	1	Solicitamos amablemente a la convocante, nos permitan participar con estuche de diagnóstico con iluminación XLH. Ya que no afecta el diagnóstico de los pacientes y es más económico. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
7	DEWIMED, S.A.		x		Estuche de diagnóstico básico	19	2	Solicitamos amablemente a la convocante, nos permitan participar con un otoscopio con iluminación XLH. Ya que no afecta el diagnóstico de los pacientes y es más económico, ¿se acepta nuestra solicitud?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
8	DEWIMED, S.A.		x		Estuche de diagnóstico básico	19	2.5	Entendemos que si se aceptan los puntos 1, 2 y 3 se eliminaría este punto, sin embargo, incluiríamos los focos para cumplir con la vida útil de 10,000 horas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
9	DEWIMED, S.A.		x		Estuche de diagnóstico básico	19	2.6	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita participar con una temperatura de color de 3000 ya que no afecta el diagnóstico del paciente. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10	DEWIMED, S.A.		x		Estuche de diagnóstico básico	19	3	Solicitamos amablemente a la convocante, nos permitan participar con un oftalmoscopio con iluminación XLH. Ya que no afecta el diagnóstico de los pacientes y es más económico, ¿se acepta nuestra solicitud?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
11	DEWIMED, S.A.		x		Estuche de diagnóstico básico	19	3.1	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita participar con un oftalmoscopio con 5 aperturas y 1 filtro, ya que además de ser más económico, cumple con las características de un diagnóstico correcto. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
12	DEWIMED, S.A.		x		Estuche de diagnóstico básico	19	3.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita participar con una temperatura de color de 3000 ya que no afecta el diagnóstico del paciente. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativo	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ARTÍCULO DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE BIENES	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	1, 2, 3, 28, 34	III Presentación de Ofertas PUNTO 1.6	Dado que en la Ciudad de México no es un requisito obligatorio, el dar de alta a los representantes legales en el Registro Público de la Propiedad, solicitamos a la convocante que este requerimiento sea optativo. Se acepta?	Deberá apogarse a lo solicitado en el punto 1.6 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la licitación.
2	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	1, 2, 3, 28, 34	III Presentación de Ofertas PUNTO 1.8 FC2	Solicitamos a la convocante nos permita presentar para las partidas de equipo médico únicamente ISO 13485 debido a que este último tiene mayor alcance que el ISO 9001. Resultaría incensario ambos documentos, puesto que el ISO 13485:2003 es específico y es el internacionalmente enfocado para dispositivos médicos, en cambio el ISO es una norma de calidad parcial y genérica y no cubre todos los ámbitos de especialidad del ISO 13485. Reiteramos que el ISO 13485 es aceptado internacionalmente para calidad de dispositivos médicos, no sucede así con el ISO 9001. De igual manera, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios no acepta el ISO 9001 para el registro de productos, esa Institución lo desecha pues no cumple con toda la certificación necesaria. ¿Se acepta entregar únicamente el ISO 13485?	Se aclara que en la presente junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo J BIS (requisitos de calidad), dejando sin efecto el Anexo J.
3	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	1, 2, 3, 28, 34	III Presentación de Ofertas	Solicitamos a la convocante que se nos permita entregar la propuesta e ingresar al acto de presentación de propuestas, mediante una persona diferente al representante legal, debidamente identificada con carta poder con firma autografa del representante legal acompañado de su identificación. Se acepta?	Podrá hacerlo de esa manera siempre y cuando su propuesta técnica y económica se encuentre firmada por el representante o apoderado legal autorizado de la empresa licitante.
4	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	1, 2, 3, 28, 34	III PRESENTACION DE OFERTAS PADRÓN DE PROVEEDORES	Entendemos que en el caso de estar dados de alta en el padrón del proveedores y el mismo se encuentre vigente, no será necesario acompañar nuestra propuesta con la documentación original ni en copia del acta constitutivo, reformas ni el poder del representante legal. Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, el presentar su registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal actualizado al 2022 los exlme de presentar únicamente los puntos 1.1 y 1.2 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la licitación.
5	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	1, 2, 3, 28, 34	II Información específica de la licitación g) Lugar y tiempo de entrega	Debido a la situación mundial, donde las cadenas de suministro han sido impactadas en la disponibilidad de materia prima, componentes y demás insumos necesarios para la fabricación de los bienes, solicitamos a la convocante considerar que el plazo de entrega de los bienes sea de 120 días naturales, posterior a la notificación de fallo. ¿Se acepta?	Se aclara que para las partidas 1, 2, 3 y 34 del Anexo I, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día 09 de octubre de 2023; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para esta partida en el Inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apogarse a la fecha señalada en el inciso g) del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativo	carácter técnico	carácter	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	x			EQUIPO MEDICO	1, 2, 3, 28, 34	Bases VII Condiciones q)	La pena convencional, la cual se determinará aplicando 2% sobre el valor de los bienes no suministrados por cada semana y/c el porcentaje que corresponda por fracción de semana de atraso a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados, ¿se encuentra topada a alguna cantidad o porcentaje?	El tratamiento de las penas convencionales será de conformidad al artículo 134 de la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato.
7	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	x			EQUIPO MEDICO	1, 2, 3, 28, 34	Bases VII Condiciones q)	La pena convencional, la cual se determinará aplicando 2% sobre el valor de los bienes no suministrados por cada semana y/c el porcentaje que corresponda por fracción de semana de atraso a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados. Entendemos no incluye el tema de penalizaciones por retrasos en la atención de mantenimiento, ¿Es correcta nuestra apreciación?	El tratamiento de las penas convencionales será de conformidad al artículo 134 de la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato.
8	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.				EQUIPO MEDICO	1 y 3	Anexo J	Favor de confirmar que los equipos a desinstalar estarán disponibles al proveedor asignado, al día siguiente del fallo establecido en la presente convocatoria.	Posterior al fallo, el licitante adjudicado deberá coordinar los trabajos de desinstalación e instalación con el personal de la unidad médica correspondiente, sin afectación al servicio.
9	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		x		EQUIPO MEDICO	1, 2, 3, 28, 34	Anexo N	Entendemos que la cantidad de mantenimientos preventivos serán conforme al manual del fabricante, es correcta nuestra apreciación?	Apegarse a lo solicitado en los Anexos J Bis y N de las bases de la presente licitación.
10	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		x		EQUIPO MEDICO	1 y 3	Anexo J Anexo M	Entendemos que los espacios donde se realizaron las visitas, son considerados definitivos para la instalación de los bienes, por lo cual no existirá ningún cambio o modificación en su lugar de instalación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
11	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		x		EQUIPO MEDICO	1, 2, 3, 28, 34	Anexo N	Dado que los tiempos logísticos se han alargado por problemas de cadena de suministro a nivel global, solicitamos a la convocante la posibilidad de extender el plazo de respuesta en caso que las refacciones que requieren un proceso de importación, manteniendo una comunicación continua con los responsables de la unidad, es posible?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo N de las bases de la presente licitación.

[Handwritten signatures and initials]

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el instituto de salud pública del estado de guanajuato

junta de aclaraciones

ÍNDICE DE PREGUNTA	REQUERIMIENTO DEL LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
12	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		X		ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR.	34	38	Debido a que la función se encuentra activa en el Software de postproceso. Solicitamos amablemente a la convocante; Se nos permita referenciar con la Hoja de Especificaciones del Software Postproceso. ¿Se acepta?	El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
13	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	1.4	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar, Tiempo de exposición 2 milisegundos o menor a un tiempo de exposición de 2 segundos o mayor, ya que este cubre todos los estudios de Rayos X requeridos por el servicio, se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
14	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	2.2	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar, Foco grueso de 1.3 mm o menor, de manera que esto no afecte de ninguna manera la adquisición y la calidad de los estudios de radiología, se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
15	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	5.2	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar sin que sea obligatorio para los demás participantes, Matriz de al menos 3500 x 4200 píxeles, tomando en cuenta que los avances de la tecnología consideran que se debe aumentar el rango de la matriz de detectores, se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
16	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		X		UNIDAD RX DIGITAL ESTUDIOS DE TÓRAX	1	10	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar sin que sea obligatorio para los demás participantes, mesa de paciente con soporte de peso del paciente de al menos 400 kg, considerando ampliar a la población pediátrica, se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
17	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		X		MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19	28	22, 22.1, 22.2	CONSIDERANDO QUE ESTOS CONSUMIBLES SON SOLAMENTE UN KIT INICIAL Y QUE EL INSTITUTO CUENTA CON OTRAS FUENTES DE ABASTO DEDICADAS A LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIONAL O SUSTITUIR POR ALGUN ACCESORIO ADICIONAL QUE PUEDA SER MAS FUNCIONAL PARA EL USUARIO Y EL EQUIPO, ENTENDIÉNDOSE COMO CABLES PARA ECG, BRAZALETES, SENSORES DE SPO2, ¿SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Industrial	Carácter Técnico	Carácter Legal	Descripción del Bien	Partida	Punto	Pregunta	Respuesta
18	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		x		MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19	28	22, 22.1, 22.2	DE SER ACEPTADA NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE EL TIPO Y CANTIDADES DE ACCESORIOS A SUSTITUIR POR EL CAMBIO DE LOS CONSUMIBLES. FAVOR DE ACLARAR.	No aplica su pregunta, en virtud de que la respuesta a su pregunta anterior no fue positiva.
19	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		x		MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19	28	SIN NUMERO	INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 20.1,20.2,20.3,1.20.3.2,20.4,21.1,21.2,21.3,21.4,22.1,22.2 PARA ESTA SOLICITUD, SE REFIERE A QUE SE DEBERÁ COLOCAR EL NUMERO DE PARTE DE ACUERDO A LA MARCA PARA CADA UNO DE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS, ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación.
20	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	x			MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19	28	SIN NUMERO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, GARANTIZANDO AL MENOS 6 AÑOS DE REFACCIONES PARA EL MODELO A OFERTAR.	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
21	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		x		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	1.3	Se solicita permitir la participación con corriente en cine digital pulsado hasta 150 mA, considerando que el pulso de cine digital es una técnica de adquisición equivalente a la fluoroscopia pulsado. ¿Se acepta por la convocante?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
22	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		x		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	3.5	Se solicita a la convocante permitir al referenciado con la literatura propia de la empresa, en este caso Wig/Wag para el movimiento panorámico, considerando que el movimiento es el mismo que solicita la convocante, ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo. Se aclara que los puntos 3.5, 3.6 y 3.7 deben decir: " 3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR. 3.6. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20° 3.7. PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG." dejando sin efecto "3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR. 3.6. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20° O PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG."

JUNTA DE ACLARACIONES

ÍNDICE DE PREGUNTAS	TIPO DE LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
23	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		x		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	3.5	Se solicita a la convocante considerar el peso del equipo como un punto a evaluar adicional, considerando que no hay relación entre movimiento lateral o panorámico de 20° y el peso del equipo, pero el peso del equipo sí representa un gran diferencial para los usuarios del equipo. ¿La convocante acepta considerar un peso del arco menor a 380 kg como un punto a evaluar por sí solo?	Se aclara que los puntos 3.5, 3.6 y 3.7 deben decir: " 3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR, 3.6. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20° 3.7. PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG." dejando sin efecto "3.5. RECORRIDO VERTICAL MOTORIZADO DE 40CM O MAYOR, 3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL QUE CUBRA UN RANGO DE 20° O PESO DEL ARCO NO MAYOR A 380KG."
24	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		x		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	7.1	Se solicita a la convocante permitir el referenciado con literatura propia de la empresa, en este caso perfiles de imagen predeterminados, considerando que los perfiles ofertados permiten ajustar la adquisición de imagen dependiendo del tipo de procedimiento a realizarse, ¿Se acepta por la convocante?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de la presente licitación.
25	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		x		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	7.4	Se solicita a la convocante permitir el referenciado con la literatura propia de la empresa, en este caso Smart Metal para la corrección de metales para aplicaciones de traumatología y ortopedia, considerando que la tecnología ofertada es la que solicita la convocante, ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
26	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		x		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	7.6	Se entiende que la convocante solicita zoom en vivo a la imagen sin aumentar la dosis, ¿Es correcta la apreciación?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
27	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		x		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	7.8	Se solicita a la convocante permitir el referenciado con la literatura propia de la empresa, en este caso Reducción de ruido mejorada y/o Filtro de ruido espado temporal, considerando que la tecnología ofertada es la que solicita la convocante, ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
28	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		x		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	7.9	Se solicita a la convocante permitir la participación con un perfil de imagen predeterminado pediátrico que reduce la dosis hasta en un 50% en todos los modos de imagen, ¿Se acepta por la convocante?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la reducción de la dosis en todos los modos de imagen acreditando claramente las características en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	CONTRIBUYENTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DE BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
29	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		x		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	12.1	Se solicita a la convocante permitir la participación con una pantalla única de 32 pulgadas, con una resolución de 4K, considerando que es una tecnología superior a la solicitada por la convocante (se muestran dos imágenes equivalentes a 20"). ¿Se acepta por la convocante?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
30	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		x		UNIDAD RX Y FLUOR MÓVIL ARCO EN C	2	14.3	Se solicita a la convocante permitir participar con cubiertas desechables en lugar de cubiertas esterilizables, considerando que se entregan 40 cubiertas, ¿Se acepta por la convocante?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando al menos sean dos cubiertas reusables o 20 cubiertas esteriles desechables.
31	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	x			TOMOGRFIA DE 64 CORTES	3	II Informacion Especifica de la Licitacion a) Visita a las Instalaciones	Se solicita a la convocante aclarar si en los diferentes sitios suministrará la potencia y voltajes necesarios para los equipos y si esto será en Baja tension o media tension	Se aclara que para la partida 3 se cuenta con un transformador dedicado para el equipo de tomografía con una capacidad de 112.5KVA y para el suministro eléctrico en baja tensión (suministro eléctrico a pío de sala de tomografía) se cuenta con un voltaje de 440V, Las condiciones y configuración del suministro eléctrico observada en la visita es la proporcionada y definitiva por parte de ISAPEG, por lo que cualquier adecuación y/o modificación a estas condiciones y configuración, deberá ser considerada en su propuesta técnica económica.
32	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	x			TOMOGRFIA DE 64 CORTES	3	II Informacion Especifica de la Licitacion a) Visita a las Instalaciones	Se solicita a la convocante aclarar si suministrarán memoria analítica de los diferentes sitios.	Se aclara que en la presente junta de aclaraciones se hace entrega de la memoria analítica del área donde se instalará el equipo.
33	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	x			TOMOGRFIA DE 64 CORTES	3	II Informacion Especifica de la Licitacion a) Visita a las Instalaciones	Se solicita ala convocante aclarar si serán porporcionadas diagramas unifilares de los siministros eléctricos de potencia de los equipos en los diferentes sitios	Como parte del desarrollo de la presente junta de aclaraciones se entregan los planos correspondientes de los lugares de instalación de las partidas 1 y 3.
34	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	x			TOMOGRFIA DE 64 CORTES	3	II Informacion Especifica de la Licitacion a) Visita a las Instalaciones	Se solicita a la convocante aclarar si hay algun tipo de acabado definido.	El licitante será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros y piso por causas de manobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes o de acuerdo a las indicaciones del Hospital.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	ELIANT	CARACTER ADMINISTRATIVA	CARACTER TÉCNICO	CARACTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
35	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		X		TOMOGRAFIA DE 64 CORTES	3	4.2	Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar sin que sea obligatorio para los demás participantes un factor de paso o Pitch de 0.516 a 1.531, ya que esto no afecta la obtención de imágenes ni el desempeño del equipo. Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
1	RSD DEL BAIJO			X	Esfigmomanómetro anerode portátil (pedestal universal)	16	FC2 COPIA SIMPLE DEL (CERTIFICADO CALIDAD ISO 9001:2015)	Se solicita a la convocante nos permita intercambiar el certificado solicitado por el (CERTIFICADO CALIDAD ISO 13485:2016) ya que el ISO 9001 es la norma Internacional que proporciona especificaciones para un sistema de gestión de la calidad que se puede aplicar en cualquier organización, independientemente de la industria, producto, servicio o tamaño de la empresa; y el ISO 13485 es un sistema de gestión integral de calidad específicamente para la fabricación de dispositivos médicos. ¿Se acepta?	Se aclara que en la presente Junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo J BIS (requisitos de calidad), dejando sin efecto el Anexo J.
2	RSD DEL BAIJO			X	Estetoscopio de capsula doble (adulto)	18	FC2 COPIA SIMPLE DEL (CERTIFICADO CALIDAD ISO 9001:2015)	Se solicita a la convocante nos permita intercambiar el certificado solicitado por el (CERTIFICADO CALIDAD ISO 13485:2016) ya que el ISO 9001 es la norma Internacional que proporciona especificaciones para un sistema de gestión de la calidad que se puede aplicar en cualquier organización, independientemente de la industria, producto, servicio o tamaño de la empresa; y el ISO 13485 es un sistema de gestión integral de calidad específicamente para la fabricación de dispositivos médicos. ¿Se acepta?	Se aclara que en la presente Junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo J BIS (requisitos de calidad), dejando sin efecto el Anexo J.
3	RSD DEL BAIJO			X	Estuche de diagnóstico básico	19	FC2 COPIA SIMPLE DEL (CERTIFICADO CALIDAD ISO 9001:2015)	Se solicita a la convocante nos permita intercambiar el certificado solicitado por el (CERTIFICADO CALIDAD ISO 13485:2016) ya que el ISO 9001 es la norma Internacional que proporciona especificaciones para un sistema de gestión de la calidad que se puede aplicar en cualquier organización, independientemente de la industria, producto, servicio o tamaño de la empresa; y el ISO 13485 es un sistema de gestión integral de calidad específicamente para la fabricación de dispositivos médicos. ¿Se acepta?	Se aclara que en la presente Junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo J BIS (requisitos de calidad), dejando sin efecto el Anexo J.
4	RSD DEL BAIJO			X	Lámpara de examinación con fuente de luz fibra óptica	21	FC2 COPIA SIMPLE DEL (CERTIFICADO CALIDAD ISO 9001:2015)	Se solicita a la convocante nos permita intercambiar el certificado solicitado por el (CERTIFICADO CALIDAD ISO 13485:2016) ya que el ISO 9001 es la norma Internacional que proporciona especificaciones para un sistema de gestión de la calidad que se puede aplicar en cualquier organización, independientemente de la industria, producto, servicio o tamaño de la empresa; y el ISO 13485 es un sistema de gestión integral de calidad específicamente para la fabricación de dispositivos médicos. ¿Se acepta?	Se aclara que en la presente Junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo J BIS (requisitos de calidad), dejando sin efecto el Anexo J.
1	Polylibex, S.A. de C.V.				Todas las partidas		Anexo I Descripción de los bienes	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-021-23 (CAGEG-021/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Junta de Aclaraciones

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARACTER DE EQUIPO	CARACTER DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	Polyubex, S.A. de C.V.				Todas las partidas	FC4 Certificado o permiso de comercialización de equipos médicos de importación. Documento	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar certificado de acuerdo al país de origen de nuestro bien, el cual es equivalente al certificado CE, FDA, JAS, de comercialización. ¿Se acepta?	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes; siempre y cuando el documento sea emitido por la autoridad sanitaria del país donde se fabrica el equipo, deberá indicar fecha de vencimiento vigente.
36	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	x		EQUIPO MEDICO	1, 2, 3, 28, 34	III Presentación de Oferta Padron de proveedores	En el caso que el poder del representante legal que esta dado de alta en el padron de proveedores del Estado y cuyo poder no este registrado ante el Registro público, se podrá firmar la propuesta por otro representante de la empresa cuyo poder si este registrado en el Registro público?	Podrá presentarla de este manera. Cabe mencionar, que en caso de resultar adjudicado, el representante legal que firme el contrato deberá estar registrado en el padron de Proveedores del Gobierno del Estado de Guanajuato y contar con el poder que lo acredite como tal inscrito en el Registro Público de la Propiedad y/o del Comercio.
37	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	x		EQUIPO MEDICO	1 y 3	III Presentación de Oferta 1.13	solicitamos a la convocante se nos permita entregar guía mecánica tipo con los requerimientos necesarios de espacios, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de voz y datos y layout con la propuesta arquitectónica (en PDF), en el entendido que el proveedor asignado deberá entregar la guía mecánica definitiva en (dwg) y el proyecto arquitectónico para su aprobación por la unidades receptoras	Apegarse a lo solicitado en las bases de la presente licitación de acuerdo a lo solicitado en el numeral III. Presentación de ofertas punto 1.13 Deberá entregar guía mecánica definitiva considerando todos los aspectos técnicos con base a la Información señalada en el Anexo GM (Guía Mecánica convocante), la visita realizada, la junta de aclaraciones y las necesidades propias de su tecnología ofertada describiendo los requerimientos necesarios de espacios, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de voz y datos, etc. de acuerdo a la tecnología ofertada

[Handwritten signatures and initials]