



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 312ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023), para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:30 horas del día 30 de junio de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.




I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

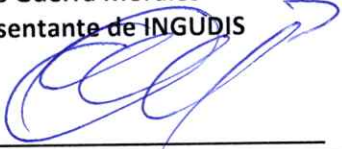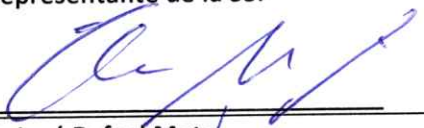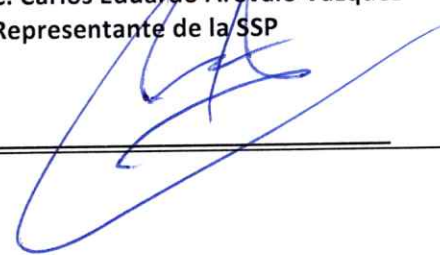
C. Elías Guerra Morales Representante de INGUDIS 	C. José Hernández Arzola Representante del INGUDIS 
C. Salvador Rosales Ramírez Representante de ITESI 	C. Jesús Ismael Mendoza Sandoval Representante de INFOSPE 
C. Andrea Aurora Rosales Camargo Representante del ISAPEG 	C. David Díaz Estrada Representante del ISAPEG 
C. Ana Carolina Hernández Gómez Representante del ISAPEG 	C. José Rubén Ruiz Sánchez Representante del ISAPEG 
C. Omar Macías Acevedo Representante de la SSP 	C. Carlos Eduardo Arévalo Vázquez Representante de la SSP 
C. José Rafael Mata Representante de la UTSMA 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023)**, para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio:

Nombre	Firma
TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. C. Juan Luis Arellano Reyes	
GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. C. Gabriel Alejandro Ortiz Borrego	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones


- Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- En el presente evento se hace entrega de los planos estructurales en formato digital e impreso, referentes a la partida 31.
- Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal


La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

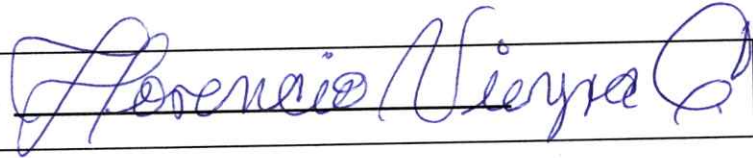


Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **11:55 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **30 de junio de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.




**Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-038-23
(CAGEG-038/2023), para la Adquisición de Equipo e
Instrumental Médico y de Laboratorio**

Planos partida 31

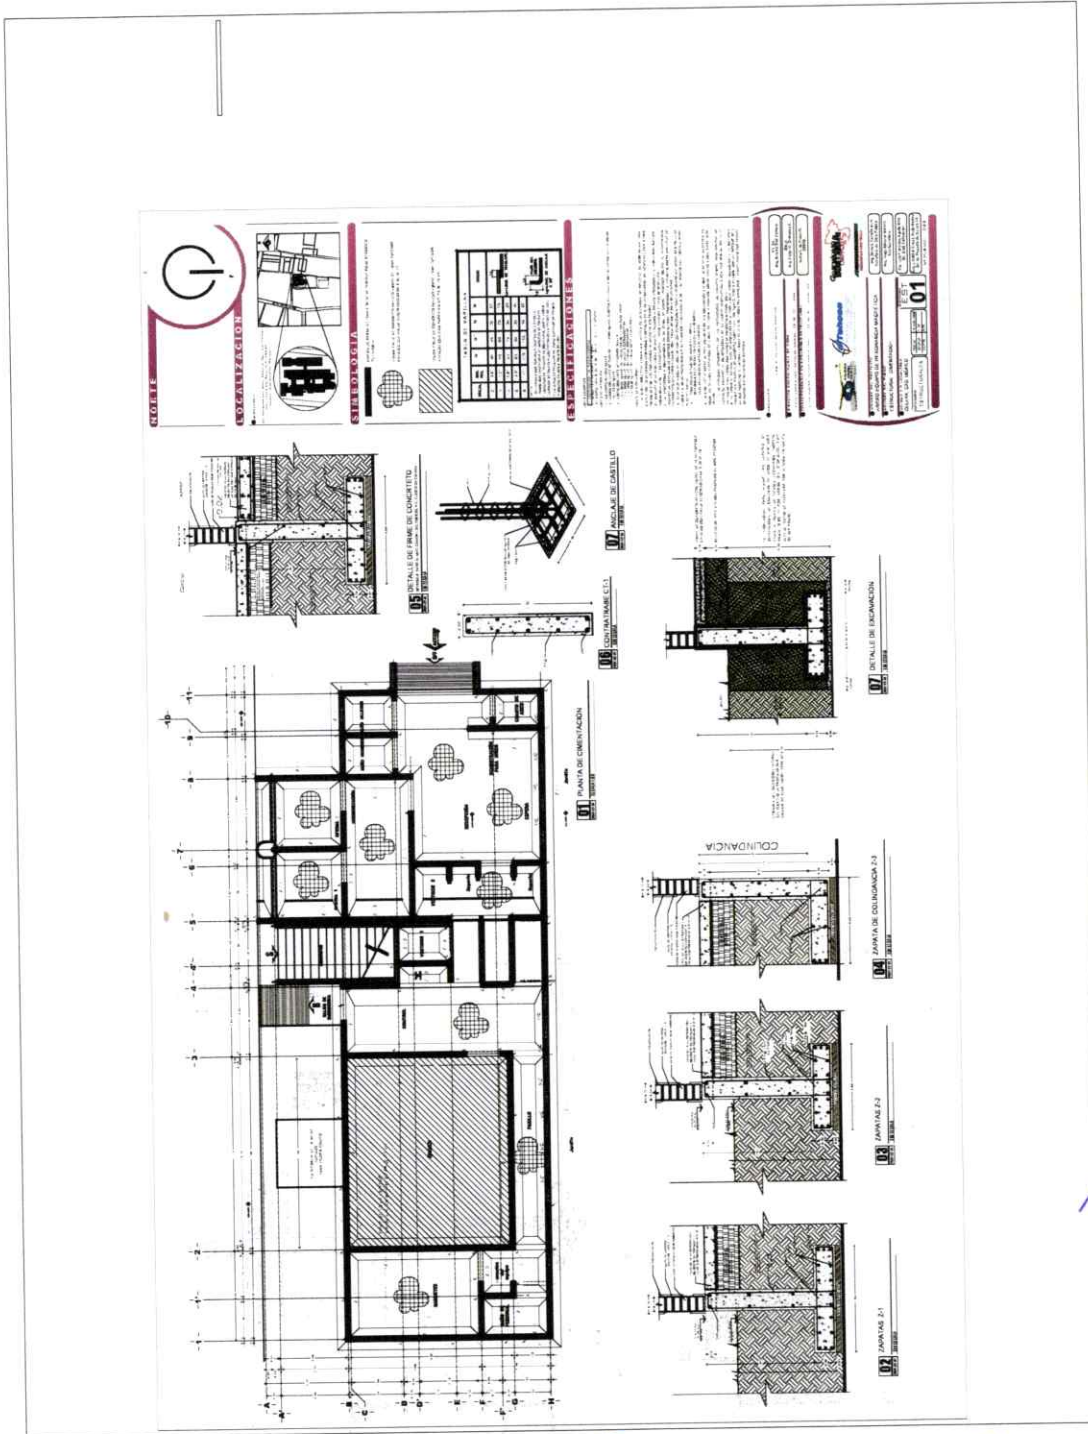

**Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-038-23
(CAGEG-038/2023), para la Adquisición de Equipo e
Instrumental Médico y de Laboratorio**

Planos partida 31

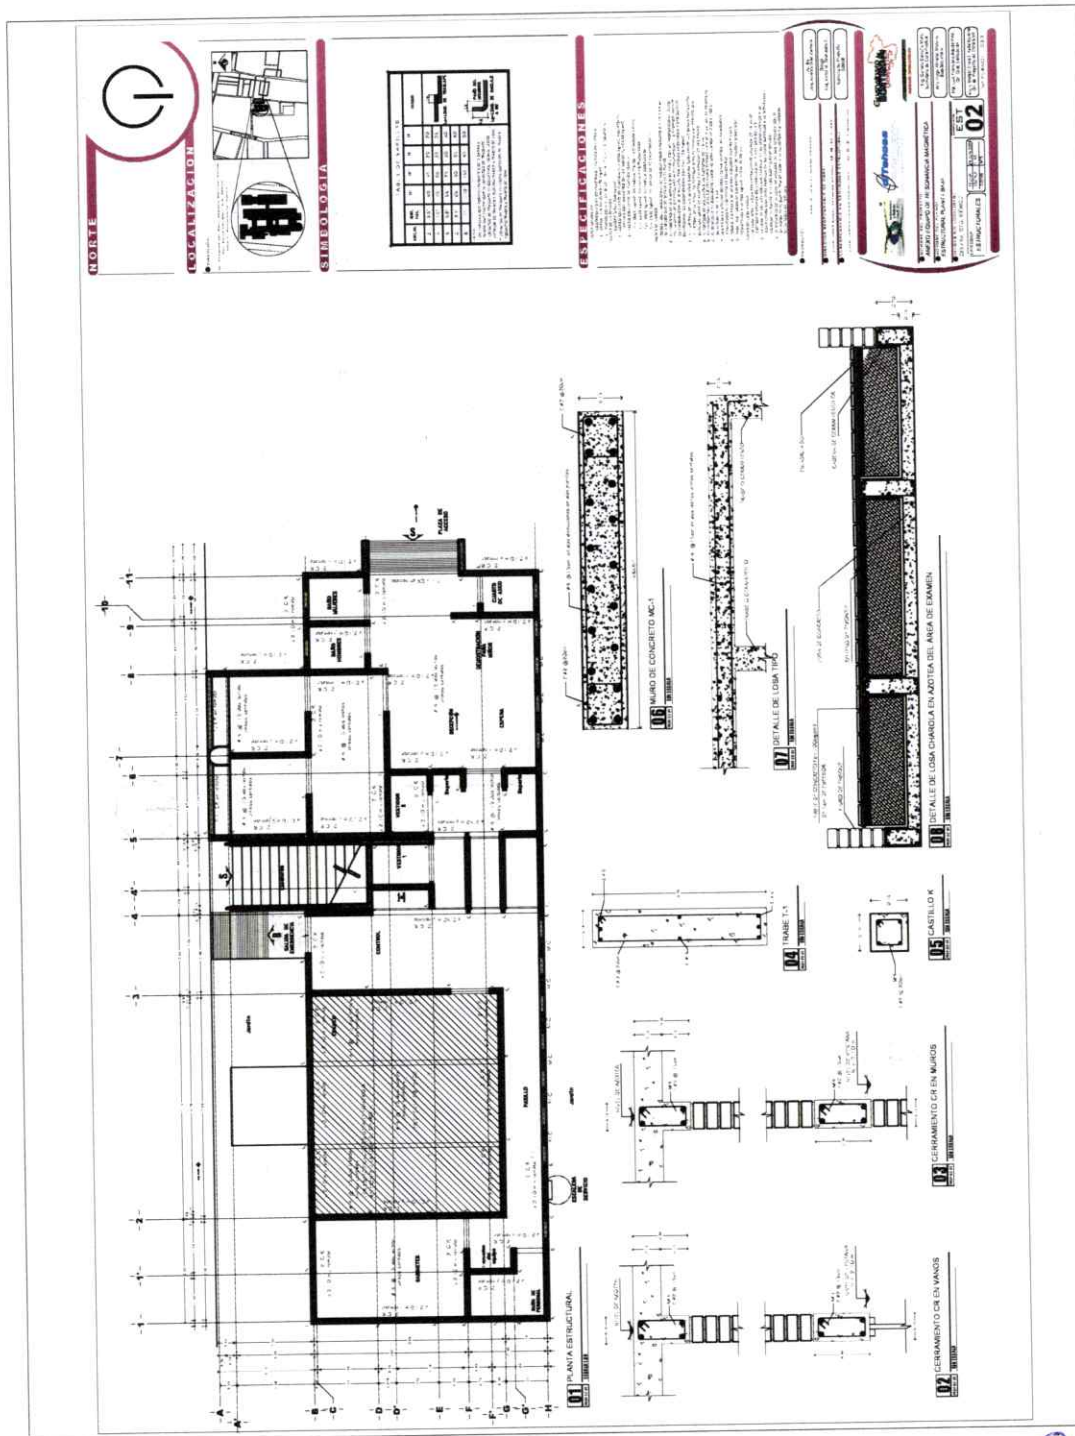

Planos partida 31

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio
 junta de aclaraciones

no. de pregunta	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
1	telecomu nicación y equipos, s.a. de c.v.	x			resonador magnético int 1.5t	31	varios	al final de la cedula dice "indicar numero de identificación de las partes....", entendemos que se refieren al modelo dque se oferta de estos puntos, ¿es correcto?	No es correcta su apreciación. Los números de identificación de las partes, hacen referencia a los números, códigos o claves de identificación de cada una de las partes que integran el equipo.
2	telecomu nicación y equipos, s.a. de c.v.	x			resonador magnético int 1.5t	31	1.8.1.1	para los monitores, la denominacion grado medico es basicamente la definicion para lo cual usteddes agregan la matriz del monitor, en nuestro caso la matriz es de 1920x1200 y dado que se esta usando en la resonancia ese termino esta implicito por lo que solicitamos se nos permita ofertarlo sin la leyenda grado medico, ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación. En caso de que no pueda referenciarlo, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
3	telecomu nicación y equipos, s.a. de c.v.	x			resonador magnético int 1.5t	31	1.10.9	entendemos que la correccion de movimiento en tiempo real, ¿es correcto?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de funciones en sus manuales y/o catálogos para efectos de evaluación.
4	telecomu nicación y equipos, s.a. de c.v.	x			resonador magnético int 1.5t	31	1.11.2	para los estudios de difusion una medicion es el adc o el eadc. entendemos que podremos usar una u otra ya que la nomenclatura eadc es propia de la marca philips, ¿es correcto?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de funciones en sus manuales y/o catálogos para efectos de evaluación.
5	telecomu nicación y equipos, s.a. de c.v.	x			resonador magnético int 1.5t	31	1.12	para todas las antenas solicitamos se nos permita usar el termino elemento o canales, ¿se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de funciones en sus manuales y/o catálogos para efectos de evaluación. Se aclara que el punto 1.12. debe decir "Bobinas, elementos o canales dedicados para:", dejando sin efecto "1.12. Bobinas:" del Anexo I y I-A de la presente licitación. Es correcta su apreciación.
6	telecomu nicación y equipos, s.a. de c.v.	x			resonador magnético int 1.5t	31	1.12	entendemos que deberemos ofertar 8 diferentes antenas, ¿es correcto?	Se aclara que el punto 1.12. debe decir "Bobinas, elementos o canales dedicados para:", dejando sin efecto "1.12. Bobinas:" del Anexo I y I-A de la presente licitación.
7	telecomu nicación y equipos, s.a. de c.v.	x			resonador magnético int 1.5t	31	1.12.3	solicitamos se nos permita ofertar una antena dedicada para hombro de 6 elementos, ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	x			RESONADOR MAGNETICO INT 1.5T	31	3.6	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR TAPONES AUDITIVOS POR SEGURIDAD DE LOS PACIENTES YA QUE LOS TAPONES AUDITIVOS SON DESECHABLES, ¿SE ACEPTA?	Se aclara que solo se requiere un solo juego de audifonos de aislamiento acústico anti magnéticos para uso pediátrico y adulto.
9	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	x			RESONADOR MAGNETICO INT 1.5T	31	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7	SOLICITAMOS PARA ESTOS PUNTOS LOS CUALES SON INFORMATIVOS Y QUE SE DEBEN CUMPLIR TA QUE SON INSTALAR TUBO DE QUENCH, LA CARGA DE HELIO, ETC., PONER LA LEYENDA SE INCLUYE O PONER CARTA DEL LICITANTE DONDE NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON ESTOS PUNTOS, ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	x			BASES DE LICITACIÓN		II INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN	Entendemos que para los eventos mencionados en los incisos c), d) y e), será suficiente el presentar las propuestas cualquier representante de la empresa, siempre y cuando presente una CARTA PODER SIMPLE, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Podrá hacerlo de esa manera siempre y cuando su propuesta técnica y económica se encuentre firmada por el representante o apoderado legal autorizado de la empresa licitante.
11	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	x			RESONADOR MAGNETICO INT 1.5T	31	II INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN	Inciso f), Entendemos que en caso de existir algun retraso por parte de la convocante, para el inicio de los trabajos en el área de intalación, el tiempo de entrega del equipo se ajustará en relación a los días que, en su caso, se hayan retrasado. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de Aclarar	No es correcta su apreciación. Se aclara que la fecha máxima de entrega para la partida 31 será a más tardar el día 15 de diciembre de 2023, dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado III. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
12	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	x			RESONADOR MAGNETICO INT 1.5T	31	ANEXO "I"	Entendemos que este anexo podrá ser entregado en nuestro papel membretado, ya que somos nosotros los que proporcionaremos los servicios de mantenimiento necesarios, para tener el equipo funcionando en óptimas condiciones. ¿Es correcta nuestra apreciación?	La carta deberá ser emitida por el fabricante ya que éste debe respaldar la capacidad que tiene el licitante de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ofertados, por lo que deberá apegarse al formato del Anexo I y a lo solicitado en este punto de la convocatoria de la presente licitación.
13	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	x			RESONADOR MAGNETICO INT 1.5T	31	ANEXO "H-I"	En nuestro caso, nosotros NO SOMOS FABRICANTES, por lo que entendemos que podremos entregar este anexo, adecuándolo e imprimiendolo en nuestro papel membretado, acompañandolo de la carta de representación exclusiva de la marca. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar	Apegarse a lo solicitado en el punto 20, del apartado III. Presentación de ofertas, de la presente licitación. El licitante deberá presentar carta solidaria original del fabricante que lo acredite como DISTRIBUIDOR o REPRESENTANTE AUTORIZADO (Anexo H).
14	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	x			RESONADOR MAGNETICO INT 1.5T	31	ANEXO "VI"	En nuestro caso, nosotros NO SOMOS FABRICANTES, por lo que entendemos que podremos entregar este anexo, adecuándolo e imprimiendolo en nuestro papel membretado, acompañandolo de la carta de representación exclusiva de la marca. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar	Apegarse a lo solicitado en el punto 20, del apartado III. Presentación de ofertas, de la presente licitación. El licitante deberá presentar carta original de vigencia de tecnología (Anexo VI) expedida por el fabricante.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
15	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. P				BASES DE LICITACIÓN		II INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN	Entendemos que para los eventos mencionados en los incisos c), d) y e), será suficiente el presentar las propuestas cualquier representante de la empresa, siempre y cuando presente una CARTA PODER SIMPLE, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Podrá hacerlo de esa manera siempre y cuando su propuesta técnica y económica se encuentre firmada por el representante o apoderado legal autorizado de la empresa licitante.
16	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. P				RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	II INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN	Inciso f). Entendemos que en caso de existir algún retraso por parte de la convocante, para el inicio de los trabajos en el área de instalación, el tiempo de entrega del equipo se ajustará en relación a los días que, en su caso, se hayan retrasado. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de Aclarar	No es correcta su apreciación. Se aclara que la fecha máxima de entrega para la partida 31 será a más tardar el día 15 de diciembre de 2023, dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado III. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
17	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. P				RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	ANEXO "I"	Entendemos que este anexo podrá ser entregado en nuestro papel membretado, ya que somos nosotros los que proporcionaremos los servicios de mantenimiento necesarios, para tener el equipo funcionando en óptimas condiciones. ¿Es correcta nuestra apreciación?	La carta deberá ser emitida por el fabricante ya que éste debe respaldar la capacidad que tiene el licitante de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ofertados, por lo que deberá apegarse al formato del Anexo I y a lo solicitado en este punto de la convocatoria de la presente licitación.
18	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. P				RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	ANEXO "H-I"	En nuestro caso, nosotros NO SOMOS FABRICANTES, por lo que entendemos que podremos entregar este anexo, adecuándolo e imprimiéndolo en nuestro papel membretado, acompañándolo de la carta de representación exclusiva de la marca. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar	Apegarse a lo solicitado en el punto 20, del apartado III. Presentación de ofertas, de la presente licitación. El licitante deberá presentar carta solidaria original del fabricante que lo acredite como DISTRIBUIDOR o REPRESENTANTE AUTORIZADO (Anexo H)
19	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. P				RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	ANEXO "VI"	En nuestro caso, nosotros NO SOMOS FABRICANTES, por lo que entendemos que podremos entregar este anexo, adecuándolo e imprimiéndolo en nuestro papel membretado, acompañándolo de la carta de representación exclusiva de la marca. ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor de aclarar	Apegarse a lo solicitado en el punto 20, del apartado III. Presentación de ofertas, de la presente licitación. El licitante deberá presentar carta original de vigencia de tecnología (Anexo VI) expedida por el fabricante.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio
 junta de aclaraciones

no. de pregunta	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
20	S.A. DE C.V. P				RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	ANEXO A: PROPUESTA TÉCNICA	Deberá presentar su propuesta técnica (Anexo A) con la liga del sitio web de fabricante para consulta de catálogo (Aplica para equipo médico general y especializado). ENTENDEMOS QUE DEBEMOS DE MENCIONAR LA PÁGINA WEB, EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS CATÁLOGOS COMERCIALES DEL EQUIPO, YA QUE LOS MANUALES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ES CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL Y NINGÚN FÁBRICANTE LOS PONE A DISPOSICIÓN DE TODO PÚBLICO (YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE A CUERDO A LOS ART. 113, Fracción II LFTAI y Art. 116 tercer párrafo LGTAIP; Contiene secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda al particular.), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR Se aclara que el aire acondicionado deberá ser de tipo paquete para el sistema de aire acondicionado para la unidad de resonancia magnética y componentes del sistema (cuarto de máquinas) y será en función de la disipación de calor emitida por los elementos del sistema de resonancia magnética de cada casa comercial y dimensiones de los locales indicados anteriormente.	Deberá presentar su propuesta técnica (Anexo A) con la liga del sitio web de fabricante para consulta de catálogo comercial del equipo. La convocante podrá verificar el sitio web del fabricante para corroborar los datos de catálogos y/o manuales proporcionados por el licitante; en caso de que haya datos contradictorios, será motivo de descalificación.
21	S.A. DE C.V.		P		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	VISITA AL ÁREA DE INSTALACIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE EL TIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE ES REQUERIDO PARA LA SALA EN LA CUAL SE INSTALARÁ EL EQUIPO OFERTADO: DE PAQUETE, MINISPLIT TIPO CASSETTE O FANYCOOL	Se aclara que el aire acondicionado deberá ser de tipo paquete para el sistema de aire acondicionado para la unidad de resonancia magnética y componentes del sistema (cuarto de máquinas) y será en función de la disipación de calor emitida por los elementos del sistema de resonancia magnética de cada casa comercial y dimensiones de los locales indicados anteriormente.
22	S.A. DE C.V.		P		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	VISITA AL ÁREA DE INSTALACIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR FAVOR NOS OBSEQUE UNA COPIA DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS DEL ÁREA DONDE SERÁ INSTALADO EL EQUIPO	Se entrega como parte de la presente junta de aclaraciones los planos arquitectónicos del servicio de resonancia magnética del Hospital General de Celaya.
1	DE C.V. X				IL INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION (INCISO a) VISITA A INSTALACIONES			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL COMPROBANTE DE LA VISITA FISICA, DEBEMOS INCLUIR EL ORIGINAL QUE NOS ENTREGARON O PUEDE SER UNA COPIA. FAVOR DE ACLARAR	Podrá presentar el documento solicitado en copia simple como parte de su propuesta técnica.
1	Suministro para uso Médico y Hospitalario S.A. de C.V. X						1.3	Solicitamos a la convocante que para cumplir con este punto nos permita entregar como ORIGINAL el documento arrojado por la página del SAT impresa a color. ¿Se acepta?	Podrá presentarlo de esta manera.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2.	Suministro para uso Médico y Hospitalario S.A. de C.V.	X					GENERAL PUNTO 3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar cartas de fabricante en copia simple, en caso de resultar adjudicado se deberá entregar original. ¿Se acepta nuestra propuesta? Para las demás partidas deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.14 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación. El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características por partida.	Para las partidas 30 y 31, se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
3	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X			TODAS LAS PARTIDAS	Página 9, III.2 Presentación de ofertas, Punto 1.19	Solicitamos a la convocante que donde no sea suficiente el texto para comprobar las características solicitadas nos permita comprobar mediante imágenes en catálogos y Manuales ¿Se acepta?	
4.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 16	Anexo I, PARTIDA 16 Punto 9	9. Modos para la toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Entendemos que al solicitar "automática" debemos ofertar un equipo con la capacidad de toma manual, por intervalos de tiempo y además con función totalmente automatizada por detección de cambios súbitos de presión en el paciente mediante la onda de pulso, ¿es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 16	Anexo I, PARTIDA 16 Punto 12	12. Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla. Entendemos que al ser un equipo destinado al traslado, por seguridad de los pacientes se deberá ofertar un equipo con batería interna recargable con duración de al menos 6 horas, con cargador interconstruido e indicador de niveles en pantalla, ¿es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6.	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.		x			PARTIDA 16	Anexo I, PARTIDA 16 Punto 21	21. Con capacidad para conectarse a ambulancia" y "22. Cable para alimentación en ambulancia. " Entendemos que podemos ofertar un conector grado médico y un equipo con la capacidad de ser alimentado con corriente alterna de 100 a 240 V, 50 a 60Hz y con una batería con capacidad de corriente directa de 6.6 a 8.2V/m, compatibles con la mayoría de los servicios de ambulancias, ¿es correcto? 23.1 Un cable troncal y dos sensores tipo dedal, reusable, para oximetría de pulso" y "24.1. Un cable troncal y dos sensores tipo dedal, reusable, para oximetría de pulso. " Nuestra tecnología, desarrollo de sensores y garantía de durabilidad, permite que se utilicen distintos tipos de sensores para cubrir a todo tipo de pacientes con el mismo cable troncal, por lo que para ahorrar costos para el instituto, solicitamos a la convocante que se nos permita ofertar un cable troncal y dos sensores tipo dedal reusable adulto-pediátricos, para oximetría de pulso, lavables y resistentes a líquidos, mismos que les permitirán ser utilizados con los dos tipos de pacientes, además al ser duraderos por su capacidad de ser lavables, ¿se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7.	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.		x			PARTIDA 16	Anexo I, PARTIDA 16 Punto 23.1 y 24.1	23.3. Un Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva adulto con una manguera reusable con conector para los brazaletes. " y "24.3. Un Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva pediátrico con una manguera reusable con conector para los brazaletes. " Nuestra tecnología, desarrollo de sensores y garantía de durabilidad, permite que se utilicen distintos tipos de brazaletes para cubrir a todo tipo de pacientes con la misma manguera doble con conector para nuestros brazaletes, por lo que para ahorrar costos para el instituto, solicitamos a la convocante que se nos permita ofertar una manguera con conector para los brazaletes, un brazalete reusable para medición de la presión no invasiva adulto y un brazalete reusable para medición de la presión no invasiva pediátrico, ¿se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8.	SUMINISTR O PARA USO MÉDICO Y HOSPITALA RIO S.A. DE C.V.		x			PARTIDA 16	Anexo I, PARTIDA 16 Punto 23.3 y 24.3	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
9.	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 16	Anexo I, PARTIDA 16 Punto 23.4 y 24.4	23.4. Un Cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos tres puntas." y "24.4. Un Cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos tres puntas." Nuestra tecnología, desarrollo de sensores y garantía de durabilidad, permite que se utilicen distintos tipos de latiguillos para cubrir a todo tipo de pacientes en distintas áreas hospitalarias con el mismo cable troncal, por lo que para ahorrar costos para el instituto, solicitamos a la convocante que se nos permita ofertar un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos tres puntas adulto-pediátrico, ¿se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10.	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 16	Anexo I, PARTIDA 16 Punto 25.1	25.1. Un Cable troncal y cuatro sensores multisitio reusable para oximetría de pulso." Nuestra tecnología y desarrollo de sensores permite que se utilicen distintos tipos de sensores para cubrir a todo tipo de pacientes con el mismo cable troncal, por lo que para ahorrar costos para el instituto, solicitamos a la convocante que se nos permita ofertar cuatro sensores multisitio para oximetría de pulso que puedan ser utilizados con el mismo cable troncal de los sensores para adulto-pediátrico, ¿se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
11.	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 20	Anexo I, PARTIDA 20 Punto 9	Punto 9. Modos para la toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Entendemos que al solicitar "automática" debemos ofertar un equipo con la capacidad de toma manual, por intervalos de tiempo y además con función totalmente automatizada por detección de cambios súbitos de presión en el paciente mediante la onda de pulso, ¿es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
12.	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 20	Anexo I, PARTIDA 20 Punto 12	Punto 12. Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla. Entendemos por seguridad de los pacientes se deberá ofertar un equipo con batería interna recargable con duración de al menos 6 horas, con cargador interconstruido e indicador de niveles en pantalla, ¿es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13.	SUMINISTRADOR PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 20	Anexo I, PARTIDA 20 Punto 19	Punto 19. DETECCIÓN DE ARRITMIAS BÁSICAS. Entendemos que por seguridad de los pacientes, facilidad de interpretación y disminución de falsas alarmas, se deberá ofertar un equipo con la capacidad de detección de al menos 25 tipos distintos de arritmias, ¿es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
14.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	X				PARTIDA 20	Anexo I, PARTIDA 20 Punto 21.1	21.1. UN CABLE TRONCAL Y UN SENSOR MULTISITIO REUSABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO". Nuestra tecnología y desarrollo de sensores permite que se utilicen distintos tipos de sensores para cubrir a todo tipo de pacientes con el mismo cable troncal, por lo que para ahorrar costos para el instituto, solicitamos a la convocante que se nos permita ofertar un sensor multisitio para oximetría de pulso que pueda ser utilizado con el mismo cable troncal de los sensores para adulto-pediátrico, ¿se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.19 MANUALES, CATALOGOS 1.20. CARTA DE FABRICANTE SUB- NUMERALES FC1, FC5, FC6, FC7, CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita para la partida de equipo Médico Especializados, solo presentar impresas las hojas referenciadas de los Manuales, para no imprimir más de 500 hojas. Se acepta?	Podrá presentar impresas únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes donde se encuentren las referencias, siempre y cuando presente de manera digital para el equipo médico especializado los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos de los bienes, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.19.
2.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.20. CARTA DE FABRICANTE SUB- NUMERALES FC1, FC5, FC6, FC7, CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE	Solicitamos amablemente a la Convocante que nos permitan presentar cartas firmas electrónicas avanzadas certificadas por la norma oficial mexicana NOM-151-SCFI-2016 de filial del fabricante en México, ¿Se acepta?	Para los documentos solicitados en el numeral 1.20 (FC1, FC5, FC6 y FC7) podrá presentarlas de esta manera.
3.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.20. CARTA DE FABRICANTE SUB- NUMERALES FC1, FC5, FC6, FC7, CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE	La Convocante está aceptando las "firmas electrónicas avanzadas certificadas por la NOM-151-SCFI-2016 para cualquier documento que se presente como por ejemplo carta de apoyo. Se Acepta?	Para los documentos solicitados en el numeral 1.20 (FC1, FC5, FC6 y FC7) podrá presentarlas de esta manera.
4.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.20. CARTA DE FABRICANTE SUB- NUMERALES FC1, FC5, FC6, FC7, CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE	¿aceptan firmas electrónicas avanzadas certificadas por la norma oficial mexicana NOM-151-SCFI-2016 para los documentos que debamos presentar?	Para los documentos solicitados en el numeral 1.20 (FC1, FC5, FC6 y FC7) podrá presentarlas de esta manera.
5.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.3. Con tecnología de ahorro de helio o similar.	El 80 % de las resonancias son susceptibles a eventos de quench, nuestra tecnología blueseal hace referencia a un magento completamente sellado con un sistema de micro-enfriamiento, ocupando únicamente 7 litros de helio en toda su vida útil sin requerir la instalación de tubo de quench y recargas adicionales de helio, disminuyendo considerablemente los riesgos de eventos de quench los cuales tienen un costo aproximado de MXN 3,000,000. oSolicitamos amablemente a la convocante que oferte un equipo de esta naturaleza o similar sea requisito para todos los resonadores ofertados.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6 C.V.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.5. Homogeneidad del campo garantizada de 1ppm o menor en un volumen de 40cm o mayor.	Dado a que la homogeneidad nos garantiza la calidad de la imagen. Solicitamos amablemente a la convocante que la homogeneidad que se requiere en un volumen de 40 cm debe ser de igual o menor a 0.55 ppm con el fin de garantizar una excelente calidad de imagen para un hospital de este nivel.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7 C.V.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.7.2. Tecnología de adquisición o sistema de RF o tecnología de RF de 64 canales o mayor	Entendemos que al solicitar una tecnología de 64 canales o mayor podemos ofertar una tecnología superior de número de canales de recepción independientes y con digitalización desde la bobina, ¿es correcta nuestra apreciación?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas.
8 C.V.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.7.3. Con método o técnica de reducción de tiempo de adquisición o incremento de la velocidad de adquisición.	Dado que se trata de un hospital de alta especialidad el cual se requiere de un flujo de trabajo muy alto y una carga de pacientes demasiado elevado es fundamental contar con un equipo que permita reducir los tiempos de adquisición de los estudios y aumentar la productividad del servicio, por lo tanto, solicitamos amablemente a la convocante que el equipo a ofertar cuente con un factor de aceleración de 15 o mayor.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9 C.V.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.10.1. Método de supresión de grasa espectral.	Entendemos que al solicitar método de supresión de grasa espectral se refiere a imágenes libres de grasa ¿es correcta nuestra apreciación?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de funciones en sus manuales y/o catálogos para efectos de evaluación.
10 C.V.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.10.3. Perfusión o TTP, MTT, 40, in. Aplicados a T1 y cerebral T2.	Solicitamos amablemente a la convocante la confirmación que este punto hace referencia a T2* perfusión para obtención de mapas y Mean Transit Time (MTT), Time To Peak (TTP), Time of Arrival (TO), Negative Integral (NI) and Index. Dado a que este tipo de software no ayudan con los buenos flujos de trabajo y productividad por sus tiempos prolongados de adquisición vs perfusión T2* solicitamos amablemente a la convocante poder cumplir con el punto 1.10.3 donde se solicita la perfusión T2* con valores cuantitativos MTT, TTP, TO, NI.	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
11 C.V.	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.10.3.1. Perfusión cuantitativa para cerebro (ASL o 3D ASL).		Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
12	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.10.6. Espectroscopia Univoxel y Multivoxel. Aplicada a cerebro.	Dado a que se trata de un hospital de alta especialidad en donde se atienden varias especialidades se solicita amablemente a la convocante poder ofertar paquete de espectroscopia aplicada a cerebro, mama, hígado y próstata y todas las ofertas puedan ofrecer este beneficio para mantener un alto nivel de especialidad en el hospital.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13	IMAGYMED S.A. DE C.V.	X			RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.10.7. Cuantificación de grasa en hígado.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos confirme que este punto hace referencia a la espectroscopia de hígado obteniendo gráficas y tablas de resultados de agua y lípidos ¿es correcta nuestra apreciación?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
14	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.11.1.1.7. Tractografía y tensor de difusión con opción de crecimiento a futuro de "estudios funcionales bold".	Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que para este punto 1.11.1.1.7 será suficiente con referenciar que el equipo puede llegar hacer esta función en caso de querer adquirirlo en el futuro ¿es correcto?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación. Deberá ofertar tractografía y tensor de difusión, la opción de crecimiento a futuro es para estudios funcionales BOLD.
15	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.11.2. Estudios de la difusión aplicados a cuerpo entero (ADC, eADC).	Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que este punto hace referencia a las imágenes de difusión corporal y procesamiento automático de imágenes de difusión con mapas ADC & eADC.	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de funciones en sus manuales y/o catálogos para efectos de evaluación.
16	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.12.5. De 32 canales o mayor para cuerpo, con cobertura de 50x50 cm o mayor.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos confirme que este punto hace referencia a una antena para cuerpo de 32 canales y con cobertura del campo de visión (FOV) 50x50 o mayor ¿es correcta nuestra apreciación?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
17	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.12.6. Antena de pie/tobillo de 8 canales o mayor.	La anatomía de pie/tobillo es considerada como extremidades por lo tanto solicitamos amablemente a la convocante si es posible omitir este punto y poder cumplir con el punto 1.12.7 donde se solicita una antena de 16 canales de propósito general o flexible o extremidades.	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación.
18	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	2.12. Robot quemador de CD y DVD.	Se solicita amablemente a la convocante se nos conforme si se requiere de 2 quemadores de CD Y DVD o existe la posibilidad de omitir el punto 1.8.5. donde también se solicita un quemador de CD y/o DVD.	Se aclara que se requiere un robot quemador para el punto 2.12 con productividad de 40 discos o más por hora. Para el punto 1.8.5 y 2.4., deberá ofertar un grabador de CD y/o DVD integrado o interconstruido a las estaciones.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
19	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	4.2. Suministro de la capacidad total requeriente de helio para el óptimo funcionamiento del equipo.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos confirme que al tener esta preocupación del suministro de helio para un buen funcionamiento del equipo de resonancia magnética requieren de una tecnología de micro enfriamiento que solo ocupe 7 litros de helio y que deberá ser requisito indispensable para todos los resonadores ofertados ¿es correcta nuestra apreciación?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
20	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	4.5. Instalación de tubo QUENCH al exterior del edificio y tubo de ventilación en caso de que la tecnología lo requiera.	Se solicita amablemente a la convocante se nos confirme que este punto hace referencia a la tecnología de resonancia magnética que no ocupe tubo de Quench ¿es correcta nuestra apreciación?	Podrán ofertarlo o no ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.
21	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	Punto 2.4.3. Programas de post procesamiento de imágenes (licencias permanentes):	2.4.3.1. Para espectroscopia, perfusión, difusión, Tractografía, estudios cardiológicos, viabilidad miocárdica o caracterización del tejido o MDE o MDI, morfología cardíaca, reforzamiento tardío (caracterización tisular), análisis o evaluación de bold, cálculo de mapa T2 musculoesquelético o articulaciones con cuantificación de T2. Se solicita amablemente a la convocante se nos confirme que el software de Tractografía y evaluación bold son opcionales, al igual que el punto 1.1.1.1.7 (Tractografía y tensor de difusión con opción de crecimiento a futuro de "estudios funcionales bold"), donde es solicitado con crecimiento a futuro, por lo que entendemos que es suficiente con Demostrar documentalmente que el equipo puede llegar hacer esta función en caso de querer adquirirlo en el futuro. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Apegarse a lo solicitado en el punto 2.4.3. y 2.4.3.1. del Anexo I y I-A de la presente licitación. Deberá incluir todos lo programas de procesamiento de imágenes con licencias permanentes; la opción de crecimiento a futuro es para estudios funcionales BOLD.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
22	IMAGYMED S.A. DE C.V.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	Punto 2.4.3. Programas de post procesamiento de imágenes (licencias permanentes):	2.4.3.1. Para espectroscopia, perfusión, difusión, Tractografía, estudios cardiológicos, viabilidad miocárdica o caracterización del tejido o MDE o MDI, morfología cardíaca, reforzamiento tardío (caracterización tisular), análisis o evaluación de bold, cálculo de mapa T2 musculosquelético o articulaciones con cuantificación de T2. La tecnología que nosotros proponemos que permite la visualización de las estructuras del cartilago integrado con mapas T2 codificados por colores. Posicionamiento de cartilago en forma, regiones estratificadas de interés, esto permite la evaluación de la variación de los valores de T2. Por lo anteriormente expuesto Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar T2 musculosquelético o articulaciones con cuantificación de T2 como: mapas de cartilago, demostrando que le equipo cumple las capacidades anteriormente expuestas. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación; cumpliendo también con las demás características solicitadas en el punto 2.4.3. y 2.4.3.1.
23	IMAGYMED S.A. DE C.V.	X			RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	II. Información específica de la Licitación inciso g) Lugar y tiempo de entrega	Debido a la escases de componentes electrónicos a nivel mundial y aunado a que los equipos ofertados son fabricados en el extranjero, solicitamos de la manera más atenta a la convocante para no limitar la libre participación ampliar el tiempo de entrega de la partida 31 a más tardar el 20 diciembre de 2023, ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se aclara que la fecha máxima de entrega para la partida 31 será a más tardar el día 15 de diciembre de 2023; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado III. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
1	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	X			TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS	Todas las partidas, excepto para las partidas 30 Y 31	Numeral III punto 1.14	Se solicita amablemente a la convocante que derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podran ser verificadas por el area usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta tecnica, como condicion de firmar el contrato, se acepta?	Debera apegarse a lo solicitado en el numeral 1.14 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. X				TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS	30	Numeral III punto 1.20 FC1, FC5, FC6 Y FC7	Se solicita amablemente a la convocante que derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podrán ser verificadas por el área usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta técnica, como condición de firmar el contrato, se acepta?	Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
3	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. X		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	7	1	Dice: MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FIJOS, COLOR GRIS O NEGRO. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, ACOJINADOS Y DESMONTABLES, COLOR NEGRO toda vez que no demerita su funcionalidad , Se acepta?	Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
4	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. X		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	7	1.1	Dice: PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO, Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar PROTECCIONES LATERALES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta?	Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
5	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. X		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	7	2.1.	Dice: ESTRIBO DE ALUMINIO ACABADO PULIDO ESTRIADO, Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar ESTRIBO DE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO ESTRIADO toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta?	Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
6	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. X		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	7	4	Dice: ESTRUCTURA (MARCO) DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 Y 7/8" DE DIAMETRO ACABADO CROMO BRILLANTE Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar :Estructura de acero esmaltado en color negro, toda ez que no demerita su funcionalidad de el bien , Se acepta?	Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
7	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. X		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	7	5	Dice: MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR GRIS Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR NEGRO toda ez que no demerita su funcionalidad , Se acepta?	Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	7	8.4	Dice: CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar ARO IMPULSOR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta?	Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		ESFIGMOMANOMETR O ANAEROIDE DE PARED ACC	23	1,10,11,15	PREGUNTA: Solicita amablemente a la convocante aclarar si requiere: Esfigmomanómetro diseñado para ser montado en la pared (Puntos 1 y 15) o Montado en base rodable de altura ajustable (Puntos 10 y 11), toda vez que ambas opciones encarecerian el producto.	Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
10	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		ESFIGMOMANOMETR O ANAEROIDE DE PARED ACC	23	10	En caso de que en la pregunta anterior se decida por ESFIGMOMANOMETRO ANAEROIDE DE PEDESTAL CON ALTURA AJUSTABLE ENTRE 90 Y 110 CM, Solicita amablemente a la convocante poder odotar: PEDESTAL CON ALTURA FIJA ENTRE 110-120 CM Toda vez que esta característica no afecta en el funcionamiento del bien, Se acepta?	Podrá ofertarlo con altura fija entre 110-120 cm.
	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		Estación de trabajo para ORL	30	2.7	Dice: Rotación del asiento (izquierda y derecha) de 200° o mayor. Sin pasos. Amablemente se solicita a la convocante confirmar que requiere que el sillón tenga una rotación completa en 360° en ambos sentidos (izquierda y derecha), siendo posicionable en cualquier ángulo de acuerdo a las necesidades y procedimientos del área usuaria, se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
12	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		Estación de trabajo para ORL	30	2.9	Dice: Respaldo reclinable de 90° a 180° (horizontal) o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante y con la finalidad de poder facilitar a los especialistas en los procedimientos endoscópicos en nariz y garganta, sea de al menos -20° o mayor, teniendo un mayor rango de inclinación a lo solicitado en la presente convocatoria, se acepta? (Se adjunta imagen de referencia)	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con todo el rango de movimiento solicitado en el punto.
	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		Estación de trabajo para ORL	30	5, 5.2	Solicitamos amablemente a la convocante que el software sea en idioma español, diseñado y patentado por el fabricante de la unidad de otorrino y así evitar tener problemas de interconectividad y compatibilidad entre los equipos.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio
 junta de aclaraciones

no. de pregunta	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
	inovacion e infraestructura biomédica 14 S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	45	1	Dice: MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FIJOS, COLOR GRIS O NEGRO. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, ACOINADOS Y DESMONTABLES, COLOR NEGRO toda vez que no demerita su funcionalidad , Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
	inovacion e infraestructura biomédica 15 S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	45	1.1	Dice: PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO, Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar PROTECCIONES LATERALES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
	inovacion e infraestructura biomédica 16 S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	45	5	Dice: MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR GRIS Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR NEGRO toda ez que no demerita su funcionalidad , Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
	inovacion e infraestructura biomédica 17 S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	45	8.4	Dice: CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar ARO IMPULSOR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
	Proveeduría de Productos y Servicios de México, 1 S.A. de C.V.		XX		KIT DE CRIMINALISTICA	11		Solicitan indicadores cónicos ¿Qué numeración debemos ofrecer y de que altura deben ser los indicadores?	Se aclara que para los indicadores cónicos la numeración deberá ser 1 al 20, más uno que indique el norte, en total 21 indicadores cónicos. La altura podrá ser entre 7.5 cm a 10 cm.
	Proveeduría de Productos y Servicios de México, 2 S.A. de C.V.		XX		KIT DE CRIMINALISTICA	11		Solicitan banderillas ¿Cuántas debemos ofrecer y en que color?	Se aclara que se solicitan de 25 banderillas de color amarillo o colores neón.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio
 junta de aclaraciones

no. de pregunta	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
3	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.		XX		KIT DE CRIMINALISTICA	11		Solicitan Kit de 3 lámparas (luz blanca, luz UV 395 NM, LUZ UV 470 NM), con pilas recargables TMX100, ¿el modelo señalado solo es de referencia? ¿podemos ofertar otro modelo de pilas recargables con características similares?	No se solicita marca o modelo en específico, por lo que podrá ofertarlo, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
4	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.		XX		KIT DE CRIMINALISTICA	11		Solicitan Rotámetro, podrían darnos mas especificaciones del Rotámetro solicitado y podrían proporcionarnos una imagen de referencia.	Se aclara que se deja sin efecto el texto "Rotámetro".
5	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.		XX		KIT DE LÁMPARAS FORENSES	12		Kit de lámparas forenses, solicitan un mini tripode flexible TMXFT1 TACTICAL MAX. ¿El modelo señalado solo es de referencia? ¿podemos ofertar otro modelo de tripode con características similares?	No se solicita marca o modelo en específico, por lo que podrá ofertarlo, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.
6	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.		XX		KIT PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA.	13		Kit para recolección de evidencia, solicitan cargador de pilas USB ¿Para que tipo de pilas debe ser el cargador?	Se aclara que la descripción se refiere a una lámpara de luz blanca y luz UV que sea recargable. O que contenga pilas que sean recargables. Las pilas pueden ser de acuerdo a cada marca y modelo ofertado por los licitantes.
7	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	XX			TODAS A EXCEPCIÓN DE LA 30 Y 31		II.g	Lugar y tiempo de entrega, están dando 25 días naturales para la entrega, al tratarse de equipos de fabricación especial y algunos de importación el tiempo otorgado es insuficiente, por lo que solicitamos de la manera más atenta se aplie el plazo de entrega a 45 días naturales ¿se acepta nuestra propuesta?	Se aclara que la fecha máxima de entrega para todas las partidas, excepto 30 y 31 será a más tardar el día 29 de septiembre de 2023; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado III. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
1	ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.		X		RESONADOR MAGNETICO INT 1.5T	31	PUNTO 2.3.	PUNTO 2.3. INYECTOR ANTIMAGNETICO DE MEDIO DE CONTRASTE. De acuerdo con los comentarios realizados por el área usuaria durante la visita a instalaciones, solicitamos a la convocante aclarar si se requiere que el inyector antimagnético de medio de contraste sea de doble cabezal.	Se aclara que el punto 2.3. debe decir "inyector antimagnético de medio de contraste de doble cabezal, compatible con consumibles de diferentes marcas", dejando sin efecto "2.3. Inyector antimagnético de medio de contraste." del Anexo I y I-A de la presente licitación.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio
Junta de aclaraciones

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, 2 S.A.				RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	PUNTO 2.4.4.	PUNTO 2.4.4. QUEMADOR DE CD Y/O DVD. Solicitamos a la convocante especificar el nivel de productividad requerido para el quemador del punto 2.4.4. Esto con el fin de garantizar la atención óptima con base en el volumen de pacientes que atiende el servicio por día.	Se aclara que se requiere un robot quemador para el punto 2.12 con productividad de 40 discos o más por hora. Para el punto 1.8.5 y 2.4.4., deberá ofertar un grabador de CD y/o DVD integrado o interconstruido a las estaciones.
	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, 3 S.A.		X		RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	PUNTO 3.6.	PUNTO 3.6. AUDÍFONOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO ANTIMAGNÉTICOS Favor de aclarar si únicamente se requeriría de un solo juego de audífonos de aislamiento acústico antimagnéticos o si también deberá considerarse incluir tapones auditivos para resonancia magnética.	Se aclara que solo se requiere un solo juego de audífonos de aislamiento acústico antimagnéticos para uso pediátrico y adulto.
	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, 4 S.A.	X			RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.8.1.1.	Solicitan "Pantalla plana, LCD o TFT, a color de 23" o mayor, grado médico. Matriz de despliegue de 1024 x 1024 o mayor." Dado que la computadora que utiliza nuestra tecnología es de 24 pulgadas, solicitamos se nos permita ofertar una matriz de despliegue de 1920x1200 píxeles, lo cual garantiza mayor resolución a la solicitada pero en un arreglo diferente ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto tales como pantalla LCD o TFT a color, grado médico.
	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, 5 S.A.	X			RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.8.2.	Solicitan "Capacidad de almacenamiento en disco duro de 470GB o mayor. ". Dado que las tecnologías actuales requieren de equipos con por lo menos 1TB de almacenamiento en disco duro, ponemos a su amable consideración para que el área usuaria cuente con la mejor tecnología se solicite un disco duro de 1TB o mayor. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, 6 S.A.	X			RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.8.3.	Solicitan "Programas para reconstrucción y matriz de reconstrucción de 1024 x 1024 o mayor ". Dado que las tecnologías actuales han avanzado en el procesamiento de imágenes y para obtener mejor calidad de imagen en menor tiempo, ponemos a su amable consideración se deba ofertar "Programas para reconstrucción y matriz de reconstrucción de 1024 x 1024 o mayor para obtención de muestras ("sample") y matriz de reconstrucción de imagen por interpolación de por lo menos 2048x2048", ya que lo anterior garantiza la mejor calidad de imagen en el menor tiempo. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	X			RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.12.3	En el punto 1.12.3. se solicita una bobina de 16 canales o mayor para hombro; sin embargo, dado a los avances en los procesos de reconstrucción de la imagen, y que nuestra tecnología cuenta con Inteligencia Artificial con la cual la reconstrucción de la imagen es comparable a las imágenes obtenidas con un sistema de 3 Teslas, la bobina de hombro de 12 canales nos permite obtener imágenes de excelente calidad ya que con nuestra tecnología en todo tiempo se deja conectada la bobina de columna de 24 canales de RF (3 elementos por sección, con un total de 8 secciones) lo que permite la conexión de diversas bobinas de arreglo en fase. Por esta razón solicitamos a la convocante nos permita ofertar la bobina dedicada a hombro con 12 canales que en conjunto con la bobina de columna incrementa las capacidades clínicas para los estudios solicitados ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación.
8	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	X			RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T	31	1.12.14	En el punto 1.12.4. se solicita una bobina de 16 canales o mayor para rodilla; sin embargo, dado a los avances en los procesos de reconstrucción de la imagen, y que nuestra tecnología cuenta con Inteligencia Artificial con la cual la reconstrucción de la imagen es comparable a las imágenes obtenidas con un sistema de 3 Teslas, la bobina de rodilla de 12 canales nos permite obtener imágenes de excelente calidad ya que con nuestra tecnología en todo tiempo se deja conectada la bobina de columna de 24 canales de RF (3 elementos por sección, con un total de 8 secciones) lo que permite la conexión de diversas bobinas de arreglo en fase. Por esta razón solicitamos a la convocante nos permita ofertar la bobina dedicada a rodilla con 12 canales que en conjunto con la bobina de columna incrementa las capacidades clínicas para los estudios solicitados ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio
 junta de aclaraciones

no. de pregunta	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
	electrónica y medicina, 9 s.a.				resonador magnético int 1.5t	31	1.12.5	En el punto 1.12.5. se solicita una bobina de 32 canales o mayor para cuerpo; sin embargo, dado a los avances en los procesos de reconstrucción de la imagen, y que nuestra tecnología cuenta con Inteligencia Artificial con la cual la reconstrucción de la imagen es comparable a las imágenes obtenidas con un sistema de 3 Teslas, la bobina decuerpo de 12 canales nos permite obtener imágenes de excelente calidad ya que con nuestra tecnología en todo tiempo se deja conectada la bobina de columna de 24 canales de RF (3 elementos por sección, con un total de 8 secciones) lo que permite la conexión de diversas bobinas de arreglo en fase. Por esta razón solicitamos a la convocante nos permita ofertar la bobina de cuerpo con 12 canales que en conjunto con la bobina de columna incrementa las capacidades clínicas para los estudios solicitados ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación.
	electrónica y medicina, 10 s.a.				resonador magnético int 1.5t	31	1.12.7	En el punto 1.12.7. se solicita una bobina de 16 canales o mayor para propósito general o flexible o de extremidades; sin embargo, dado a los avances en los procesos de reconstrucción de la imagen, y que nuestra tecnología cuenta con Inteligencia Artificial con la cual la reconstrucción de la imagen es comparable a las imágenes obtenidas con un sistema de 3 Teslas, nuestras bobinas de 12 canales nos permite obtener imágenes de excelente calidad ya que con nuestra tecnología en todo tiempo se deja conectada la bobina de columna de 24 canales de RF (3 elementos por sección, con un total de 8 secciones) lo que permite la conexión de diversas bobinas de arreglo en fase. Por esta razón solicitamos a la convocante nos permita ofertar la bobina de propósito general o flexible o de extremidades con 12 canales que en conjunto con la bobina de columna incrementa las capacidades clínicas para los estudios solicitados ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación.
	electrónica y medicina, 11 s.a.				resonador magnético int 1.5t	31	4.4, 4.5 y 4.6	Se solicita amablemente a la convocante nos permita entregar como referencia al punto 4.4, 4.5, 4.6 carta compromiso de cumplimiento o que dichos elementos se mencionen en la Guía Mecánica del equipo dentro de nuestra propuesta, ¿se acepta?	Podrán ofertarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio
 junta de aclaraciones

no. de pregunta	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
12	electrónica y medicina, s.a.	x			resonador magnético int 1.5t	31	4.7	En el punto 4.7. se solicita el software de los equipos en idioma español; dado a que esta función se encuentra en proceso de desarrollo por fábrica siendo lanzado el año 2024, se solicita a la Convocante nos permita entregar como referencia a este punto una Carta Compromiso indicando que una vez que esté disponible se instalará el software en idioma español, ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación. El licitante deberá asegurar que el software del equipo esté en idioma español para el funcionamiento óptimo del servicio dentro de la unidad médica.
13	electrónica y medicina, s.a.	x			resonador magnético int 1.5t	31		Se solicita amablemente a la Convocante indicar si es posible reutilizar el transformador actual de la Resonancia.	El licitante adjudicado podrá reutilizar el transformador existente de 112.5KVA exclusivo para el servicio de resonancia magnética, si la capacidad del transformador no es suficiente para la tecnología del equipo ofertado, deberá considerar el cambio del transformador como parte de su propuesta. De igual manera, deberá considerar en su propuesta económica el cambio del cableado de transformador hacia el cuarto del equipo de la resonancia magnética.
1	DEWIMED, s.a.		x		Estación de trabajo para otorrinolaringología	30	2.8	En el punto 2.8 dice Elevación del asiento de 74cm o mayor. Solicitamos a la convocante que para facilitar la libre participación nos permita ofertar elevación del asiento de 51.43cm (20 1/4 in) a 73.02 cm (28 3/4 in), sin que esto afecte el funcionamiento del sillón. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	DEWIMED, s.a.		x		Estación de trabajo para otorrinolaringología	30	4.5	En el punto 4.5 dice sistema para regulación de presión analógico o digital con escala de 0 a 4 Kg/cm2. Solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación, se nos permita ofertar manómetro analógico ajustable de 0.2 a 4.0 BAR, sin que esto afecte el funcionamiento de la unidad. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	DEWIMED, s.a.		x		Estación de trabajo para otorrinolaringología	30	4.8	En el punto 4.8 dice sistema eléctrico de calentamiento con indicador de temperatura para agua y soluciones. La estación que estamos ofertando cuenta con un termostato y un sistema de seguridad adicional donde la temperatura del calentador de agua y endoscopios está ajustada de fábrica a 37 °C. Solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación poder ofertar el sistema de calentamiento antes mencionado. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio
 junta de aclaraciones

no. de pregunta	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
								En el punto 4.9 dice con al menos cuatro cajones configurables y área o espacio destinado a instrumental sucio. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar: Dos cajones totalmente extensibles y de cerrado suave, 2 niveles para instrumentos con bandejas de acero inoxidable, bandeja de instrumentos de acero inoxidable para los instrumentos utilizados con un inserto de silicona y cubo de basura-apertura con pedal (cierres automático). ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	DEWIMED, S.A.		X		Estación de trabajo para otorrinolaringología	30	4.9	El punto 4.10 dice "con multicontacto para conexión de accesorios de la estación". Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar un multicontacto independiente del gabinete de la unidad para cumplir con este punto. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación.
5	DEWIMED, S.A.		X		Estación de trabajo para otorrinolaringología	30	4.1	En el punto 5.4 dice Monitor grado médico. Solicitamos amablemente a la convocante que ya que la unidad otorrinolaringológica es un equipo exclusivo para consultorio y para no encarecer el sistema de endoscopia poder ofertar un monitor clínico que cuenta con características idóneas para tal práctica. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación.
6	DEWIMED, S.A.		X		Estación de trabajo para otorrinolaringología	30	5.4	Solicitamos amablemente a la convocante que ofertar este punto sea opcional, debido a que en las salas de procedimientos de ORL en donde usualmente se instalan las unidades otorrinolaringológicas no es común que se realicen intubaciones a pacientes que van por una consulta, diagnóstico, evaluación o terapia. Solicitamos poder ofertar en su lugar un otoscopio con mango metálico, espéculos para uso continuo de diferentes tamaños y balón de insuflación para prueba neumática en el tímpano. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación.
7	DEWIMED, S.A.		X		Estación de trabajo para otorrinolaringología	30	6.2, 6.2.1 y 6.2.2	Solicitamos se acepte un rango de +-10% en las medidas del instrumental	Apegarse a lo solicitado para estas partidas en el Anexo I.
8	DEWIMED, S.A.		X		Para las partidas de instrumental			En el punto 8.0 solicitan Alimentación eléctrica 120V +/- 10%, 60Hz. La unidad que ofertamos funciona a 220V debido a su origen Alemán. Solicitamos a la convocante poder ofertar un transformador que permita conectar nuestra unidad de 220V a la red eléctrica de 120V a fin de cumplir con este punto de la ficha técnica. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9	DEWIMED, S.A.		X		Estación de trabajo para otorrinolaringología	30	8		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
					Estación de trabajo para otorrinolaringología	30	8	En el punto 8.0 solicitan Alimentación eléctrica 120V +/- 10%, 60Hz. La unidad que ofertamos trabaja a 220V e incluye un transformador que le permite trabajar con el voltaje solicitado de 120V, 60Hz, sin afectar funcionalidad alguna. Entendemos que incluir este transformador nos permite cumplir con dicho punto de la ficha técnica. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10 S.A.	DEWIMED,		X					Solicitamos que se nos indique si la tijera solicitada es recta o curva	Se aclara que se solicita tijera wescot curva.
11 S.A.	DEWIMED,		X		Tijera Wescot	32	s/p	Favor de aclarar si lo solicitado es una pinza castroviejo para sutura de 0.12 mm	Es correcta su apreciación. Se aclara que la descripción técnica para esta partida debe decir: "PORTA AGUJAS FINO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, CURVO SIN RETEN MODELO BARRAQUER ANGULADA SIN DIENTES PARA PUNTOS O PARA INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR RAMAS DE 9MM, LONGITUD DE 120MM"
12 S.A.	DEWIMED,		X		Pinza Castro viejo	33	s/p		Dejando sin efecto el texto: "PORTA AGUJAS FINO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, CURVO SIN RETEN MODELO BARRAQUER, RAMAS DE 9MM, LONGITUD DE 120MM"
13 S.A.	DEWIMED,		X		Porta agujas fino	39	s/p	Solicitamos que nos indiquen el modelo y medida de lo requerido	
14 S.A.	DEWIMED,		X		Rotador de nucleo	40	s/p	Se oferta manipulador de irrigación para núcleo 13 cm de longitud modelo NEUHANN ¿se acepta?	Se aclara que se solicita Rotador de Nucleo y Lente Intra Ocular Angulado de 120 mm de longitud
15 S.A.	DEWIMED,		X		Pinza MC Pherson	41	s/p	Solicitamos que nos proporcionen más especificaciones técnicas de lo requerido	Apegarse a lo solicitado en esta partida en el Anexo I.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	II Información específica de la Licitación	Solicitamos atentamente a la convocante, en apego a lo señalado en el Título Quinto, Capítulo I, Artículo 42. Impedimentos para participar en procesos de contratación y Capítulo II, Licitación Pública, Artículo 62, de la Ley de Contrataciones públicas del estado de Guanajuato, en las cuales se señala que mi representada no está impedida para participar en procedimientos de contratación y que la convocatoria deberá contener las mismas condiciones para todos los participantes, nos permita realizara un segunda visita a las instalaciones para obtener la información relativa a los trabajos de obra necesarios y así acreditar esta misma para dar cumplimiento al punto II ' Información específica de la Licitación , a) visita a instalaciones. En el entendido que lo anterior no otorga ventaja alguna a mi representada. Así mismo, como lo indica el Artículo 68. Junta de Aclaraciones y Visitas a Sitio que indica lo siguiente: Cuando proceda, se podrá señalar por la convocante lugar, fecha y hora para visita o visitas al sitio de realización de los servicios o trabajos o bien, para la verificación física de los bienes o sus muestras.	Apegarse a lo establecido en el inciso a) del Apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.
2	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	II Información específica de la Licitación	Con la finalidad de que la convocante pueda tener mayor concurrencia y así obtener mas opciones de ofertas económicas y tecnológicas, y que satisfagan las necesidades del instituto como de la derechohabencia. Solicitamos a la convocante que se otorgue una nueva fecha para visitar el sitio y acreditar esta misma para dar cumplimiento al punto II ' Información específica de la Licitación , a) visita a instalaciones solicitado en las bases. Se acepta?	Apegarse a lo establecido en el inciso a) del Apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.
3	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	1.3 Original de la Opinión del Cumplimiento	Entendemos que para cumplir este punto, se tiene que entregar impreson a color de la opinion digital. Es correcta nuestra apreciacion?	Podrá presentarla de esta manera.
4	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	1.6 Documentos legales con los que acredite su personalidad jurídica	Solicitamos a la convocante que nos permita entregar Poder Notarial no inscrito en el Registro Público y firmar la propuesta por un Representante legal que este dado de alta en el padron de proveedores del estado	Apegarse al numeral 1.6 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. X				EQUIPO MEDICO	31	1.12 Oferta técnica	Entendemos que cuando no exista numero de parte, se podrá colocar el modelo del equipo. Es correcta nuestra apreciación?	Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.12 del Apartado III. Presentación de ofertas. En caso de que en los manuales, catálogos o documentación técnica, no haya referencia de la totalidad de los números de identificación de las partes que componen el bien, deberá presentar carta del fabricante donde indique el "No. de identificación de las partes que componen el bien ofertado" solicitados en el Anexo I-A.
6	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. X				EQUIPO MEDICO	31	1.14 Carta de fabricante	Es correcto entender que dicha carta puede ser emitida y firmada por la entidad matriz global, controladora de las plantas filiales que manufacturan los equipos? Acompañando la misma de la certificación respecto a dichas filiales de la entidad matriz global. Se acepta?	Podrá presentar la carta solicitada con la firma de la entidad matriz global, siempre y cuando mencione que es controladora de las plantas filiales que manufacturan el equipo a ofertar. De igual manera deberá presentar carta de respaldo expedida por la entidad matriz global acreditando al licitante.
7	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. X				EQUIPO MEDICO	31	1.16 Guía mecánica	Solicitamos a la convocante se nos permita entregar guía mecánica tipo con los requerimientos necesarios de espacios, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de voz y datos y layout con la propuesta arquitectónica (en PDF), en el entendido que el proveedor asignado deberá entregar la guía mecánica definitiva en (dwg) y el proyecto arquitectónico para su aprobación por la unidades receptoras	Apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.16. Deberá entregar guía mecánica definitiva para la partida 31 del Anexo I de forma impresa y en formato digital (.dwg).
8	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. X				EQUIPO MEDICO	31	FC2: Copia simple del certificado de calidad	Entendemos que este requerimiento es exclusivo para el equipo principal. Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación. Deberá considerar entregar los certificados de calidad de acuerdo al Anexo I-A y J de la presente licitación.
9	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. X				EQUIPO MEDICO	31	FC3: Copia del Registro Sanitario	Entendemos que este requerimiento es exclusivo para el equipo principal. Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación. Deberá considerar entregar los certificados de calidad de acuerdo al Anexo I-A y J de la presente licitación.
10	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. X				EQUIPO MEDICO	31	FC4: Certificado	Entendemos que este requerimiento es exclusivo para el equipo principal. Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación. Deberá considerar entregar los certificados de calidad de acuerdo al Anexo I-A y J de la presente licitación.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
11	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	III PRESENTACION DE OFERTAS	Solicitamos a la convocante que se nos permita entregar la propuesta e ingresar al acto de presentacion de propuestas, mediante una persona diferente al representante legal, debidamente identificada con carta poder con firma autografa del representante legal que firmó la propuesta, acompañado de su identificación. Se acepta?	Podrá presentarla de esta manera.
12	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	1. Fianza por el 12%	Entendimos que las penas convencionales estaran topadas al valor de la fianza. Es correcta nuestra pareciacion?	Es correcta su apreciación.
13	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	VII. Condiciones m) Los pagos se tramitarán	Para el tema de facturación, Solicitamos a la convocante que nos proporcione los siguientes datos para no tener problemas futuros con la facturación: Regimen Fiscal Uso del CDFI	Los datos de facturación se señalarán en el pedido o contrato respectivo.
14	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	II. Información específica de la Licitación g) Lugar y tiempo de entrega	Debido a la situación mundial, donde las cadenas de suministro han sido impactadas en la disponibilidad de materia prima, componentes y demás insumos necesarios para la fabricación de los bienes, solicitamos a la convocante considerar que el plazo de entrega de los bienes sea el día 15 de Diciembre de 2023. ¿Se acepta?	Se aclara que la fecha máxima de entrega para la partida 31 será a más tardar el día 15 de diciembre de 2023; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado III. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
15	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.		X		EQUIPO MEDICO	31	Anexo H	Solicitamos a la convocante, que este escrito pueda ser firmado por la empresa titular de los Registros Sanitarios	Podrá presentar la carta solicitada con la firma del titular de los registros sanitarios, siempre y cuando adjunten el documento del fabricante que acredite al titular del registro sanitario.
16	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.		X		EQUIPO MEDICO	31	Anexo J	Favor de confirmar que los equipos a desinstalar estarán disponibles al proveedor asignado, al día siguiente del fallo establecido en la presente convocatoria.	Posterior al fallo, el licitante adjudicado deberá coordinar los trabajos de desinstalación e instalación con el personal de la unidad médica correspondiente, sin afectación al servicio.
17	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.		X		EQUIPO MEDICO	31	Anexo J Anexo M	Entendemos que el espacio donde se realizo la visita, es considerado como definitivo para la instalación de los bienes, por lo cual no existirá ningún cambio o modificación en su lugar de instalación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
18	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	II Información específica de la licitación	Se solicita a la convocante aclarar: ¿Qué tipo de equipo de aire acondicionado se considerará en las áreas a adecuar? es conveniente que los concursantes coticemos el mismo equipo para que todos estemos en igualdad de condiciones al cotizar, la experiencia previa nos indica que el equipo, tipo paquete es el adecuado.	Se aclara que el aire acondicionado deberá ser de tipo paquete para el sistema de aire acondicionado para la unidad de resonancia magnética y componentes del sistema (cuarto de máquinas) y será en función de la disipación de calor emitida por los elementos del sistema de resonancia magnética de cada casa comercial y dimensiones de los locales indicados anteriormente.
19	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	II Información específica de la licitación	Se solicita a la convocante aclarar: respecto a la mención de reutilizar el cableado existente de la subestación el cual, tiene 13 años de antigüedad, consideramos que, para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación y equipos, es necesario instalar cableado nuevo y así todos los concursantes estemos en igualdad de condiciones al cotizar. ¿podemos considerar esta propuesta?	Es correcta su apreciación, deberá considerar en su propuesta económica el cambio del cableado de transformador hacia el cuarto del equipo de la resonancia magnética.
20	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	II Información específica de la licitación	Se solicita a la convocante indique si para la desinstalación del equipo existente ¿llevara embalaje de madera? ¿se almacenará dentro de la institución?	Es correcta su apreciación, el embalaje deberá ser en una estructura tipo tarima de material madera y deberá considerar la maniobra de almacenamiento dentro del Hospital en planta baja, en la ubicación que indique la unidad médica.
21	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	II Información específica de la licitación	Respecto a la mención de reutilizar el transformador de 112.5 kvas existente, consideramos que, para garantizar el correcto funcionamiento de este equipo, es necesario suministrar e instalar uno nuevo y así todos los concursantes estemos en igualdad de condiciones al cotizar. ¿podemos considerar esta propuesta?	El licitante adjudicado podrá reutilizar el transformador existente de 112.5KVA exclusivo para el servicio de resonancia magnética, si la capacidad del transformador no es suficiente para la tecnología del equipo ofertado, deberá considerar el cambio del transformador como parte de su propuesta. De igual manera, deberá considerar en su propuesta económica el cambio del cableado de transformador hacia el cuarto del equipo de la resonancia magnética.
22	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	II Información específica de la licitación	Se solicita a la convocante indicar: Respecto a la mención de reutilizar la puerta y cristal de la jaula de Faraday existente, consideramos que, para garantizar el correcto funcionamiento de este, es necesario suministrar e instalar la puerta y cristal nuevo y así todos los concursantes estemos en igualdad de condiciones al cotizar. ¿podemos considerar esta propuesta?	Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas. Referente a la puerta y vidrio RF podrá ser reutilizados siempre y cuando se proporcione el certificado de hermeticidad que garantiza los requisitos de atenuación de energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) solicitados por el fabricante, sin comprometer el interior de sala de examen, exterior de sala de examen y calidad de imágenes médicas; cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes.

licitación pública nacional presencial no. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	Carácter Administrativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
23	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.		X		EQUIPO MEDICO	31	II Informacion especifica de la licitacion	Durante la visita Se menciona que hay variaciones de voltaje dentro de la institucion, ¿podria la convocante aclarar so habra una solucion por parte del hospital o si se debe ofertar una solucion que para la instalacion eléctrica del equipo ofertado?	Se aclara que las variaciones observadas en el suministro eléctrico en el hospital son de +/-5% , cualquier solución necesaria adicional deberá ser considerada en su propuesta técnico económica.
24	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.		X		EQUIPO MEDICO	31	II Informacion especifica de la licitacion	Durante la visita se solicitó entregar una prueba bacteriológica a las tomas de gases medicinales ¿podrian especificar qué tipo de prueba o pruebas solicitan?	Se aclara que son pruebas de análisis microbiológicos y fisicoquímicos en las líneas de gases medicinales.
25	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.		X		EQUIPO MEDICO	31	II Informacion especifica de la licitacion	Se solicita a la convocante aclarar si Cuenta el instituto con cálculos estructurales, planos estructurales o algún documento que indique las características del piso dentro de la sala (resistencia del concreto, armado, espesor de la losa etc., etc)	Se entrega como parte de la presente junta de aclaraciones los planos estructurales del servicio de resonancia magnética del Hospital General de Celaya.
26	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.		X		EQUIPO MEDICO	31	II Informacion especifica de la licitacion	Se solicita ala convocante aclarar si es posible ubicar el UPS en la azotea dentro de una caseta con temperatura controlada.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando considere en su propuesta económica llevar a cabo las adecuaciones necesarias y requerimientos específicos solicitados por parte del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento y protección a la intemperie. En caso de requerir elaborar y/o modificar vanos para el paso de cableado y/o suministros, deberá considerar el reemplazo del sistema de impermeabilizante de la azotea.
27	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.		X		EQUIPO MEDICO	31	II Informacion especifica de la licitacion	Se solicita a la convocante aclarar, ¿el cuarto de control puede cerrarse por medio de una puerta para tener mayor control de temperatura?	Podrá ofertarla sin ser obligatorio a los demás licitantes, siempre y cuando no afecte el funcionamiento del área ni el flujo del personal y del mobiliario rodable. Deberá respetar los acabados actuales o similares con los que se cuenta en la unidad médica
28	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.		X		EQUIPO MEDICO	31	II Informacion especifica de la licitacion	Se solicita a la convocante compartir el plano (archivo en DWG) del área donde se instalará el equipo	Se entrega como parte de la presente junta de aclaraciones los planos arquitectonicos del servicio de resonancia magnética del Hospital General de Celaya.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	PREGUNTA	RESPUESTA
29	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.							Se entiende que el instituto entregara lista el area al licitante adjudicado, entendiendose lo siguiente: • Higienización y limpieza del equipo con respecto a cualquier material contaminante o cortante (sangre, fluidos, jeringas, vidrios, etc...) Limpieza de memoria del equipo y almacenamiento de datos, con respecto a datos de los pacientes (Leyes de confidencialidad de información). • Retiro de muebles y documentos de propiedad del Hospital de los recintos. • Identificación del interruptor de protección del ramal alimentador del equipo • Quencheo del equipo	El licitante adjudicado deberá coordinar los trabajos de instalación con el personal del Hospital General Celaya, acordando las condiciones de entrega del área de resonancia magnética.
30	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	II Información específica de la licitación	Dado que la tecnología de los equipos médicos actuales tienen diferentes requerimientos sobre la necesidad de mantenimientos preventivos, se puede ajustar la recurrencia de acuerdo a lo mencionado en manual de servicio por equipo independientemente si son más o menos de los 2 mantenimientos solicitados por manual, se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.18. de la presente licitación (Anexo N).
31	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	Anexo N	De acuerdo a la solicitud de tener un soporte en línea para corrección de fallas y monitoreo del sistema vía remota, en caso de que se realice la atención y/o solución de la falla, esta se considerará dentro de la respuesta solicitada de 48 horas	La atención mediante soporte en línea debe ser solucionada dentro de las 24 horas y en caso de requerirse un mantenimiento correctivo deberá atenderse conforme a lo establecido en la CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ESPECIALIZADO 1 AÑO) Resonador Magnético (Anexo N).
32	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	Anexo N	En caso de reportes proactivos o solicitudes de servicio que sean solucionadas vía remota, es posible documentarlas a través de un correo electrónico por el especialista en línea para documentar el cierre de la solicitud	Es correcta su apreciación.
33	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	Anexo N	Podrían especificar que tipos de mantenimientos correctivos que detonarían el reemplazo del equipo	En caso de que el equipo y componentes solicitados presenten más de 3 mantenimientos correctivos durante el periodo de garantía derivados de defectos de fabricación, vicios ocultos, materiales y/o instalación, el proveedor será notificado y deberá hacer efectiva la garantía, cambiando el equipo en cuestión por tecnología funcional y nueva, sin que esto implique ningún gasto adicional al ISAPEG.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-038-23 (CAGEG-038/2023) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
34	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	X			EQUIPO MEDICO	31	ANEXO I-A. (PARTIDAS 30 Y 31) 1.7.2.	Entendemos que por tecnología de RF de 64 canales se refieren a la posibilidad de adquirir 64 señales de RF independientes de manera simultánea. ¿Es correcta esta apreciación?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para
	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		X			31	Anexo N	Listado de problemas mas comunes o frecuentes y su posible solución. ¿Es correcto entregar el listado descrito en el manual de operador donde se encuentran los procedimientos mas comunes para problemas de uso?	Podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando contenga toda la información necesaria para resolución de problemas más comunes por el área usuaria.
35	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		X		EQUIPO MEDICO	31		DICE: 2.3 ANCHO DE 68 CM COMO MINIMO. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MESA DE EXPLORACIÓN CON LONGITUD TOTAL INCLUYENDO MIEMBROS INFERIORES DE 61 CM, YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DE LA CAMILLA Y NO REPRESENTA NINGÚN RIESGO PARA EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		MESA DE EXPLORACION	6	2.3	DICE 3.3.1. DESLIZABLE O CON SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA NIVELAR LA SUPERFICIE DE FORMA AUTOMÁTICA. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TALONERAS RETRÁCTILES Y REMOVIBLES Y PIERNAS GINECOLÓGICAS CON ELEVACIÓN DE MIEMBROS INFERIORES AJUSTABLE. ¿SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
2	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		MESA DE EXPLORACION	6	3.3.1	1.20 Deberá presentar los certificados y documentos para aseguramiento de calidad que se señalan en el ANEXO J. Subnumeral EC3: Copia del Registro Sanitario. Subpunto 1. Prórroga del registro sanitario emitido por la COFEPRIS, la cual deberá coincidir con las características solicitadas del producto, con la marca, modelo, fabricante y procedencia, dicho documento tendrá que acompañarse de la copia legible del registro sanitario de origen.	Para el registro sanitario del inyector de medio de contraste, podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	Instal Pro, S.A. de C.V.		X		RESONADOR MAGNETICO INT 1.5T	31		Solicitamos amablemente convocante que en caso presentar comprobante de tramite modificación del registro sanitario de los accesorios de la RMI (Inyector Medio de contraste), nos permitan presentar además copia simple del registro anterior o del 2011 como de origen, esto para cumplir con lo solicitado ya que el registro de origen fue emitido en el año 2002 y por tratarse de un documento con más de 20 años ya no se cuenta este mismo. ¿se nos acepta nuestra petición?	